


# Instrumentation restérilisable



Catalogue de vente 2018

[www.fci.fr](http://www.fci.fr)

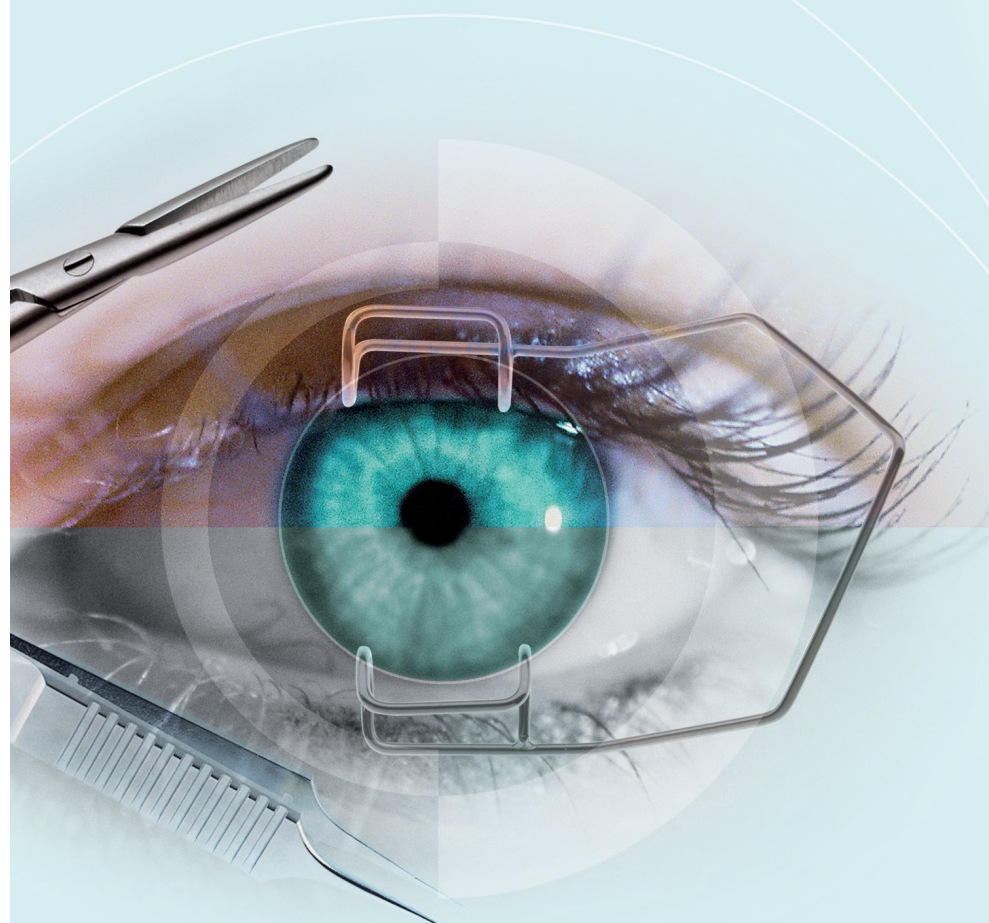

**FCI**®

France Chirurgie Instrumentation



# SOMMAIRE

## PAR ORDRE ALPHABETIQUE

Aiguille à corps étrangers	p.1	Pincés	p.25
Anses	p.1	Capsulaires	p.25
Blépharostat	p.2	A capsulorhexis	p.25
Boites de stérilisation	p.4	Chalazion	p.26
Canules	p.6	A cils	p.27
Cataracte	p.6	Cornée	p.28
Double courant	p.8	A disséquer	p.30
Voies lacrymales	p.10	A fixer	p.31
Lasik	p.10	A glaucome	p.31
Ciseaux	p.11	Hémostatiques	p.32
A cornée	p.11	A implants	p.33
D'énucléation	p.13	A monofilament	p.34
D'explantation	p.13	A strabisme	p.35
A iris	p.13	A suture	p.36
D'ophtalmologie	p.14	Plaque à paupière	p.37
Ténotomie	p.16	Porte-aiguilles	p.37
Couteaux	p.17	Porte-lames	p.38
Compas	p.17	Réglettes	p.39
Crochets	p.18	Releveurs	p.40
A implantation	p.18	Rongeur	p.41
A phaco	p.19	Spatules	p.42
A paupière	p.20	Trépan	p.42
A strabisme	p.21	Voies lacrymales	p.43
Curettes	p.23	Boite de chirurgie Rétine	p.44
Ecarteurs	p.24	Boite de chirurgie Paupière	p.45
Marqueurs	p.24	Boites chirurgicales	p.46
		Notice de nettoyage et entretien	p.50
		Index	p.51
		Conditions générales de vente	p.54



## Aiguille à corps étranger

**A1.4000**


Aiguille à corps étrangers



## Anses

**A2.5000**

Anse de Snellen



**A2.5100**

Anse irrigatrice de Pearce


## Blépharostats



**A1.1000**

Blépharostat de Barraquer Colibri 5mm

*Nourisson*

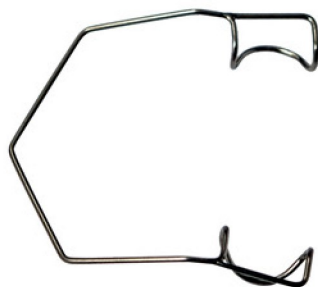

**A1.1010**

Blépharostat de Barraquer Colibri 10mm

*Enfant*



**A1.1020**

Blépharostat de Barraquer Colibri 15mm

*Adulte*



**A1.1030**

Blépharostat de Kratz

# BLEPHAROSTATS



**A1.1100**

Blépharostat de Corcelle



**A1.1400**

Blépharostat de Castroviejo à vis



**F307C**

Blépharostat de Corcelle à vis



**F307E**


Blépharostat Colibri réglable

## Boîtes de stérilisation

**A8.3000**

Boite Plastique — Petite


160 x 70 x 20 mm

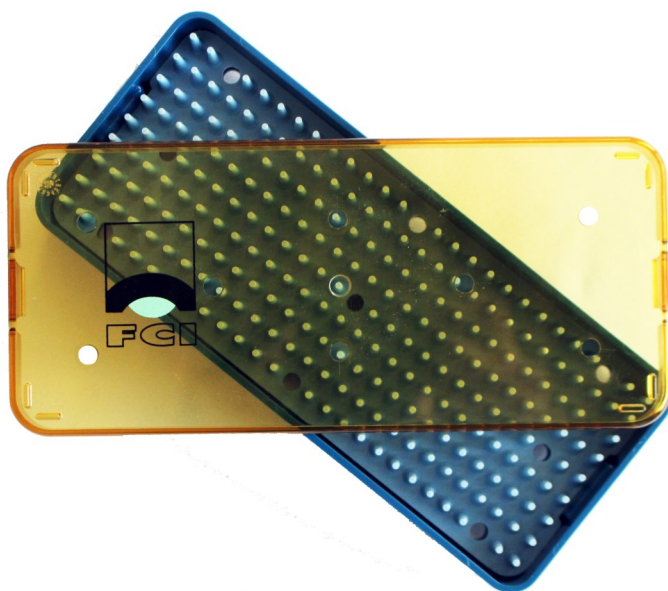

**A8.3003**

Boite Plastique — Moyenne

170 x 108 x 20 mm

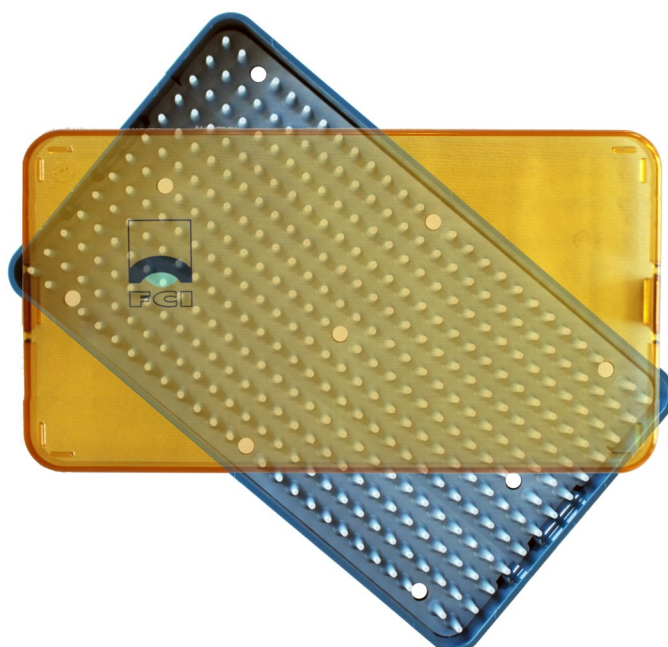




# BOITES DE STERILISATION

**A8.3005**

Boite Plastique — Grande


260 x 160 x 20 mm

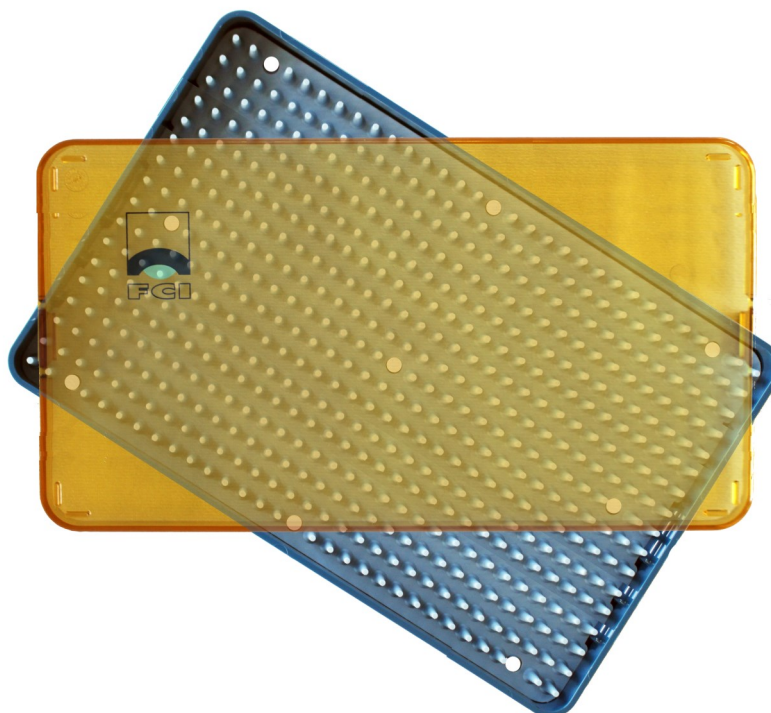


**A8.3010**

Boite Plastique à deux étages— Grande

260 x 160 x 20 mm

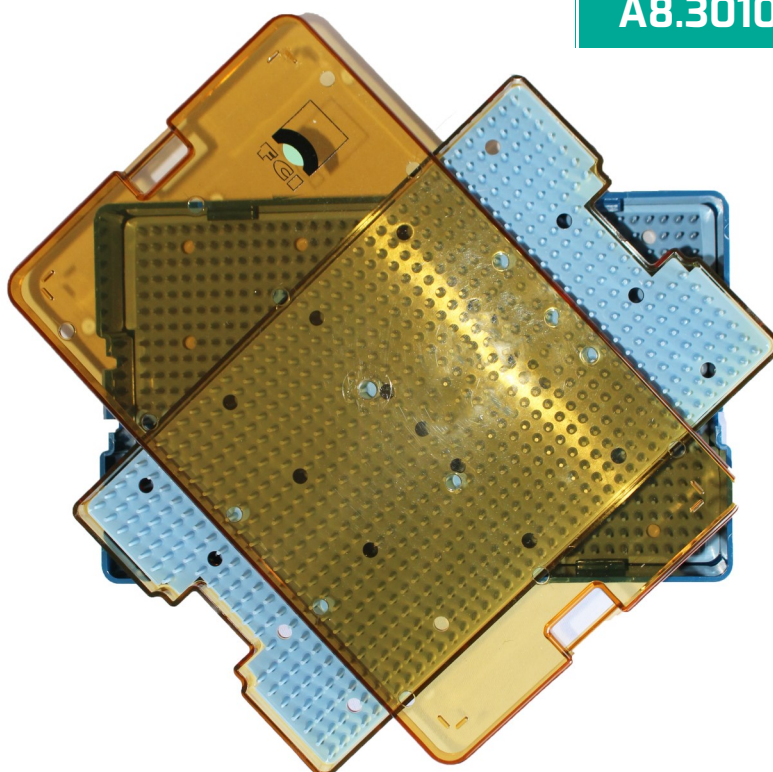

## Cataracte



**A5.1000**


Canule de Charleux 13 mm  $\varnothing$  0.6 mm

**A5.1010**

Canule de Charleux 13 mm  $\varnothing$  0.5 mm


**A5.1015**

Canule de Charleux 13 mm  $\varnothing$  0.4 mm




**A5.1020**

Canule de Charleux 20 mm  $\varnothing$  0.6 mm




**A5.1050**

Canule de Simcoe  $\varnothing$  0.3 mm




**A5.1100**

Canule de Binkhorst  $\varnothing$  0.6 mm




**A5.1110**

Canule de Binkhorst à gauche




**A5.1120**

Canule de Binkhorst à droite




**A5.1341**

Canule d'irrigation  $\varnothing$  1.0 mm




**A5.1342**

Canule d'irrigation  $\varnothing$  0.6 mm




**A5.1343**

Canule de Guerin



**A5.1344**

Canule de Guerin




**A5.1460**

Canule de Chazalon


**A5.1465**

Canule de Chazalon pour gaucher




**A5.1600**

Canule pour hydrodissection  $\varnothing 0.4\text{ mm}$



**A5.2000**

Canule pour le healon



**A5.2113**


Canule de Rycroft

$\varnothing 0.3\text{ mm}$

**A5.2114**

Canule de Rycroft


$\varnothing 0.4\text{ mm}$



**A5.2200**

Canule de Barraquer


$\varnothing 0.4\text{ mm}$



**A5.4100**

Canule gratteuse


$\varnothing 0.5\text{ mm}$



**A5.4200**

Canule de Charleux Gratteuse


# CANULES



**A5.4300**

Canule de Kratz Gratteuse

## Double courant



**A5.1213**


Canule THX double courant  $\varnothing 0.3\text{ mm}$

**A5.1222**

Canule THX double courant  $\varnothing 0.2\text{ mm}$


**A5.1234**

Canule THX double courant  $\varnothing 0.4\text{ mm}$




**A5.1235**

Canule THX.Teyssier  $\varnothing 0.6\text{ mm}$




**A5.1240**

Canule THX modifiée Turut  $\varnothing 0.6\text{ mm}$



**A5.1300**



Canule double courant de Simcoe inversée  
 $\varnothing 0.3\text{ mm}$



**A5.1350**

Canule double courant de Simcoe originale


Ø 0.3 mm

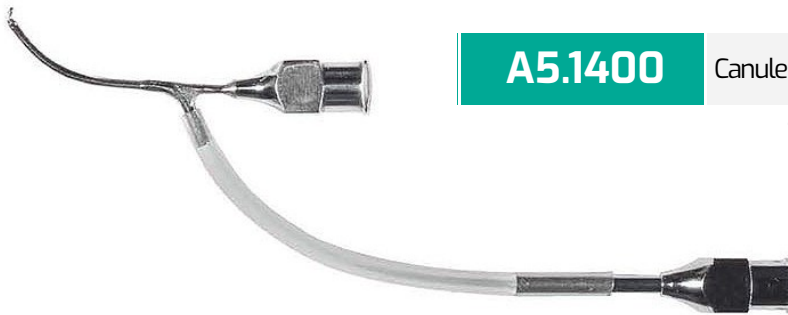

**A5.1400**

Canule THX double courant « Club de golf »


Trou d'aspiration latéral ; Ø 0.3 mm



**A5.1410**

Canule THX double courant « Club de golf »

Trou d'aspiration distal



**A5.1500**

Canule THX modifiée Laforge

Ø extérieur 1.5 mm



**A5.1450**

Tube silicone

1 mètre

## Voies Lacrymales



**A5.5000**

Canule de Galezowski

14 mm



**A5.5200**

Canule de Galezowski

18 mm

## Lasik



**A5.1470**

Canule pour Lasik

## à Cornée

**A3.4000**

Ciseaux de Vannas

*Lames 8 mm, droit, mousse*



**A3.4010**

Ciseaux de Vannas

*Lames 8 mm, courbe, mousse*



**A3.4020**

Micro-Ciseaux de Vannas

*Lames 5 mm, droit, mousse*



**A3.4030**

Micro-Ciseaux de Vannas


*Lames 5 mm, courbe, mousse*



**F1520P**

Micro-ciseaux de Vannas droit

*Lames 8 mm, droit, pointu*

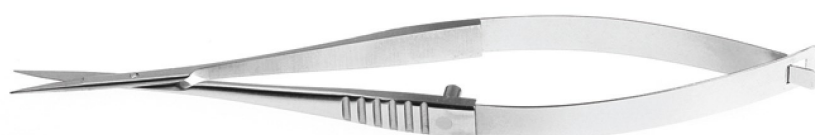

**F1521MP**

Micro-ciseaux de Vannas

*Lames 7 mm, courbe, pointu*



**A3.3100**

Ciseaux de Castroviejo


*Lames normales, mousse*



**A3.3110**

Ciseaux de Castroviejo


*Petites lames, mousse*

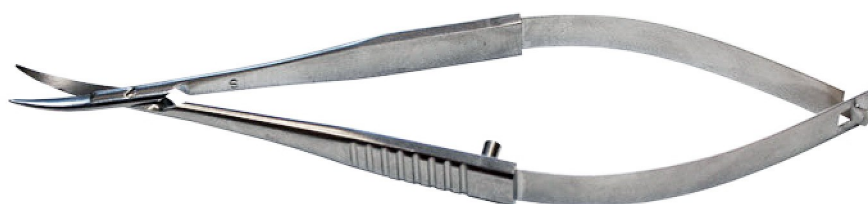

**A3.3250**

Ciseaux de Katzin à lames inversées


*Lames normales, à droite*

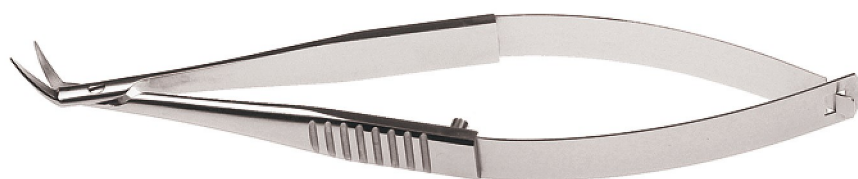

**A3.3260**

Ciseaux de Katzin à lames inversées à gauche


*Lames normales, à gauche*

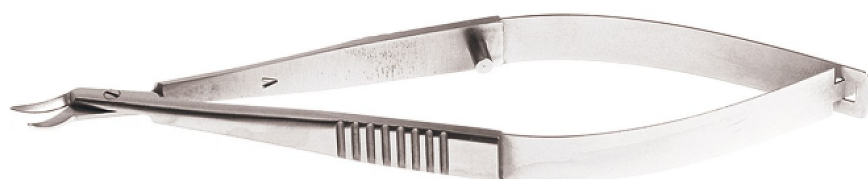

**A3.3270**

Micro-ciseaux de Katzin à lames inversées à droite

*Micro lames, à droite*

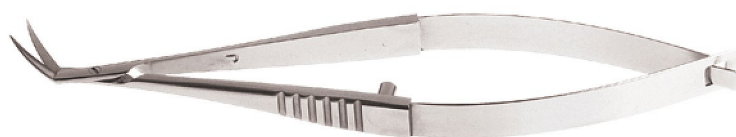

**A3.3280**

Micro-ciseaux de Katzin à lames inversées à gauche

*Micro lames, à gauche*





## d'Énucléation

**A3.1300**

Ciseaux à énucléation



## d'Explantation

**F1520I**

Micro-ciseaux coupe implants du Dr Jadé



## à Iris

**A3.2000**

Ciseaux à iridectomie de Wecker

*Lames 8 mm*



**A3.2010**

Ciseaux à iridectomie de Barraquer

*Lames mousses, 7 mm*



## d'Ophthalmologie



**A3.1000**

Ciseaux de Bonn

*9 cm, droit, mousse*



**A3.1010**

Ciseaux de Bonn

*9 cm, courbe, mousse*



**A3.1020**

Ciseaux de Bonn

*9 cm, droit, pointu*



**A3.1030**

Ciseaux de Bonn

*9 cm, courbe, pointu*

**A3.1100**

Ciseaux d'Ophtalmologie

*10.5 cm, droit, mousse*



**A3.1110**

Ciseaux d'Ophtalmologie

*10.5 cm, courbe, mousse*



**A3.1120**

Ciseaux d'Ophtalmologie

*10.5 cm, droit, pointu*



**A3.1130**

Ciseaux d'Ophtalmologie

*10.5 cm, courbe, pointu*



## à Ténatomie



**A3.1200**

Ciseaux de Sevrin Stevens

*Droit, mousse*



**A3.1210**

Ciseaux de Sevrin Stevens

*Courbe, mousse*



**A3.1220**

Ciseaux de Sevrin Stevens

*Droit, pointu*



**A3.1230**

Ciseaux de Sevrin Stevens

*Courbe, pointu*

**A3.3000**

Ciseaux de Westcott

*Courbe, mousse*



## Couteaux

**A1.3405**

Couteau cliveur de Paufigue

5 mm



**A1.3406**

Couteau cliveur de Paufigue

6 mm



## Compas

**A2.6000**

Compas de Castroviejo



**A2.6020**

Compas de Sourdille

24 mm gradué en 0.5 mm




## à Implantation



**A2.4400**

Crochet de Sinskey




**A2.4410**

Crochet de Sinskey modifié Cornic



**A2.4700**

Crochet de Lester




**F903A**

Micro-Manipulateur de Buratto



**A2.4320**

Crochet bouton de col




**A2.4300**

Micro-crochet à iris de Bonn




## à Phaco



**A2.4510**

Manipulateur d'Arneodo



**A2.4511**

Manipulateur d'Arneodo Vachet



**A2.4520**

Manipulateur de Lebuissou




**F905B**

Micro-Manipulateur de Buratto



**A2.4500**

Crochet de Jaffe Bechert



**F904A**

Micro-Manipulateur de Clayman (Crofazon)



**A2.4550**

Phaco-Chopper




# CROCHETS

## à Paupière



**A2.4200**

Crochet de Gillis, grand modèle



**A2.4210**

Crochet de Gillis, petit modèle



**A2.4220**

Double crochet de Ferron





## à Strabisme

**A2.4010**

Crochet à Strabisme de Graefe

**A2.4060**


Crochet de Gass Rouchy

**A2.4070**

Crochet à DR

**A2.4110**

Crochet d'Arruga main droite

**A2.4120**

Crochet d'Arruga main gauche

**F807B**

Crochet de Green-Malbran

**F808A**

Crochet de Hugonnier



# CROCHETS

**F810A**

Crochet à strabisme , petit modèle



**F811A**

Crochet à strabisme: grand modèle



**F807C**

Myomètre de Roth Rapp

*Instrument associé à la spatule de Pechereau*



## Curettes

**A2.1101**

Curette à voie lacrymale de J.A. Bernard



**A2.1115**

Curette à chalazion de Meyerhoefer

Ø 1,5 mm



**A2.1120**

Curette à chalazion de Meyerhoefer

Ø 2,0 mm



**A2.1125**

Curette à chalazion de Meyerhoefer

Ø 2,5 mm



**A2.1135**

Curette à chalazion de Meyerhoefer

Ø 3,5 mm



**A2.2200**

Curette à éviscération



# ECARTEURS / MARQUEURS

## Ecarteurs

**A1.2210**

Ecarteur de Bonn



**A1.2300**

Ecarteur de Wolkmann

*4 griffes mousses*



**A9.2100**

Ecarteur de Knapp

*4 griffes mousses, 6 mm*



## Marqueurs


**A2.7710**

Marqueur pour le DR




**A4.1400**

Marqueur de Hoffer




## Capsulaires



**A6.1300**

Pince de Kelman Mc Pherson

*Coudée, 11 mm, avec plateaux*



**F145C**

Pince de Mc Pherson

*Coudée, 11 mm, avec plateaux*



## à Capsulorhexis



**A6.1530**

Pince de Corydon

*Courbe, bouts pointus, corps plat, titane*



**A6.1520**

Pince de Corydon

*Courbe, bouts pointus, corps rond, titane*




**F142M**

Pince capsulorhexis de Corydon

*Courbe titane. acier, incision 2.2 mm*




# PINCES



**F142MI**

Pince capsulorhexis du Dr Dimaggio

*Titane.acier, micro.incision 1.8 mm*



**F142MIV**


Pince capsulorhexis micro-incision

*Titane.acier, micro.incision 1.8 mm*



**F142D**


Pince à mouvements croisés du Dr Zaluski



**A6.1500**

Pince d'Utrata


*Bouts mousses*



**A6.1510**

Pince d'Utrata courbe


*Bouts mousses*



**A6.1540**

Pince d'Utrata

*Bouts mousses, corps plat, titane*



**A6.1550**

Pince d'Utrata

*Bouts mousses, corps rond, titane*



**F142U**

Pince Ultrata à mouvements croisés du Dr Zaluski



**S5.3100**

Pince de Watzke pour rétine



## Chalazion

**A6.2020**

Pince à chalazion de Desmarres

20 mm



**A6.2026**

Pince à chalazion de Desmarres

26 mm



**F101B**

Pince à chalazion du Dr Sgard autobloquante 26 mm




## à Cil

**A6.3000**

Pince à cils de Barraquer




## Cornée



**A6.7100**

Pince de Bonn

*Micro.plateaux, 7 cm  
1 x 2 dents, 0.12 mm*



**A6.7110**

Pince de Bonn


*Micro.plateaux, 10 cm  
1 x 2 dents, 0.12 mm*



**A6.7140**

Pince de Bonn

*Micro.plateaux, titane, corps plat  
1 x 2 dents, 0.12 mm*



**A6.7130**

Pince de Bonn

*Micro.plateaux, titane, corps rond  
1 x 2 dents, 0.12 mm*







**A6.5150**

Pince Colibri




**A6.7200**

Pince de Barraquer Colibri



*Micro.plateaux  
1x2 dents, 0.12 mm angulées à 90°*



**A6.7210**

Pince de Barraquer Colibri



*Micro.plateaux  
1x2 dents, 0.12 mm angulées à 120°*


## à Disséquer



**A6.3100**

Pince à disséquer

*Droite, mors striés*



**A6.3120**

Pince à disséquer

*Droite*

*1x2 dents, 0.7 mm*



**A6.3150**

Pince d'Adson Brown

*Mors striés*



**A6.3160**

Pince d'Adson

*1x2 dents*



**A6.3170**

Pince d'Adson droite




## à Fixer



**A6.6000**

Pince d'Elschnig à droit supérieur

*Droite, 1x2 dents*



**A6.6010**

Pince d'Elschnig à droit supérieur

*Courbe, 1x2 dents*



**A6.6210**

Pince à fixer de Green

*10 mm*



## à Glaucome




**F127B**

Pince de Mermoud



## Hémostatiques

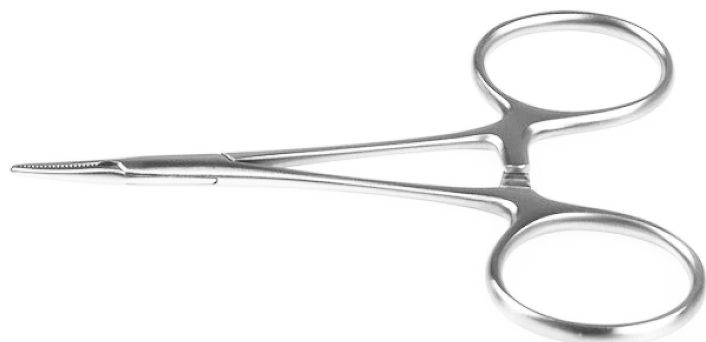

**A6.4000**

Pince de Halsted

10 cm, droite, mors striés



**A6.4010**

Pince de Halsted

10 cm, 1x2 dents



**A6.4020**

Pince de Halsted

10 cm, courbe, mors striés



**A6.4100**

Pince puce

5 cm, droite

## à Implants


**A6.9160**

Pince à saisir les implants souples



# PINCES


## à Monofilament



**A6.5060**

Pince de Harms Tubingen

*Courbe, sutures 7.0 à 9.0*



**A6.5100**

Pince de Harms Tubingen

*Droite, sutures 9.0 à 11.0*



**A6.5110**

Pince à monofilament Troutman

*Courbe, sutures 9.0 à 11.0*



**A6.5120**

Pince de Halsted

*Courbe, titane, corps rond*



**A6.5130**

Pince de Halsted

*Courbe, titane, corps plat*




**A6.9000**

Pince de Cornic



## à Strabisme



**F103C**

Pince de Blascovics



**A6.4200**

Pince à champs



## à Suture

**A6.8000**

Pince de Paufique

*Dents 0.5 mm*



**A6.8012**

Pince à sutures de Castroviejo

*0.12 mm*

**A6.8030**

Pince à sutures de Castroviejo

*0.3 mm*

**A6.8050**

Pince à sutures de Castroviejo

*0.5 mm*



**A6.8060**

Pince de Jayle

*Dents de 0.26 mm, mors de 0.8 mm*





# PLAQUE À PAUPIÈRE / PORTE-AIGUILLES

## Plaque à Paupière

**A1.2100**

Plaque à paupières de Jaeger

*Courbe, 12 cm*



## Porte-Aiguilles

**A7.1000**

Porte-Aiguille de Castroviejo

*Droit, gros mors, 15 cm*



**A7.1010**

Porte-Aiguille de Castroviejo

*Courbe, gros mors, 15 cm*



**A7.1100**

Porte-Aiguille de Castroviejo

*Droit, mors fins, 15 cm*



**A7.1110**

Porte-Aiguille de Castroviejo

*Courbe, mors fins, 15 cm*



# PORTE-AIGUILLES

**A7.1120**

Porte-Aiguille de Castroviejo à arrêt

*Droit, mors fins, 15 cm*



**A7.1130**

Porte-Aiguille de Castroviejo à arrêt

*Courbe, mors fins, 15 cm*



**A7.1200**

Porte-Aiguille gros manche



**A7.1400**

Porte-Aiguille de Halsey

**A7.1410**

Porte-Aiguille de Halsey mors tungstène



**A7.2010**

Micro Porte-Aiguille de Castroviejo

*Courbe, 12 cm*



# PORTE-AIGUILLES

**A7.3010**

Micro Porte-Aiguille Barraquer Troutman

*Courbe, mors très fins, 10 cm*



**A7.3100**

Porte-Aiguille de Barraquer

*Droit, mors très fins, 13 cm*



**A7.3110**

Porte-Aiguille de Barraquer


*Courbe, mors très fins, 13 cm*



**A7.3130**

Porte-Aiguille de Barraquer à arrêt

*Courbe, mors très fins, 13 cm*

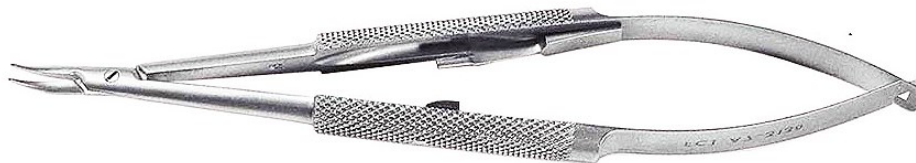

**A7.3200**

Micro Porte-Aiguille de Cornic

*Micro-mors becs dégagés, 13 cm*



**A7.3210**

Micro Porte-Aiguille de Cornic

*Micro-mors becs dégagés, titane, 13 cm*



## Porte-Lames

**A1.5000**

Porte-lame de Troutman

*Droit, 9 cm*



**A1.5040**

Lames de rasoir

*Paquet de 10*



**A1.6000**

Manche bistouri n°3




## Réglettes

**F182A**


Réglette de Pechereau

*Instrument associé au Myomètre de Roth-Rapp*

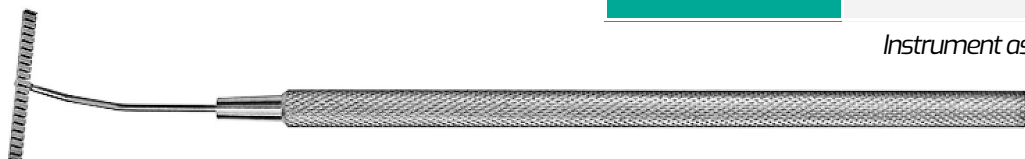

**A1.2350**

Réglette de 10 cm, graduée en demi mm

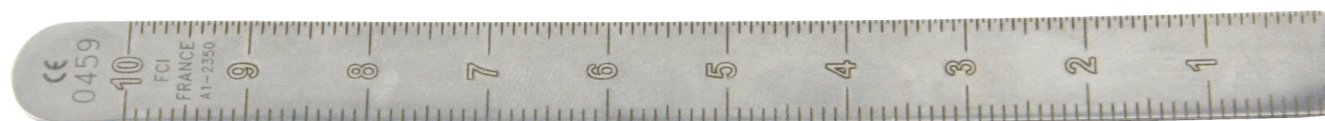

## Releveurs

**A1.2010**

Releveur à paupières de Desmarres

10 mm



**A1.2012**

Releveur à paupières de Desmarres

12 mm



**A1.2014**

Releveur à paupières de Desmarres

14 mm



## Rongeur

**A9.1000**

Rongeur de Kerrison



## Spatules

**A2.3401**

Spatule à Iris de Culler



Largeur de 1mm

**A2.3500**

Spatule de Barraquer




Très fine, longueur de 12 mm



**A2.3600**

Spatule de Cornic




**A2.3720**

Bissecteur de Teyssier




**F182A**

Réglette de Pechereau

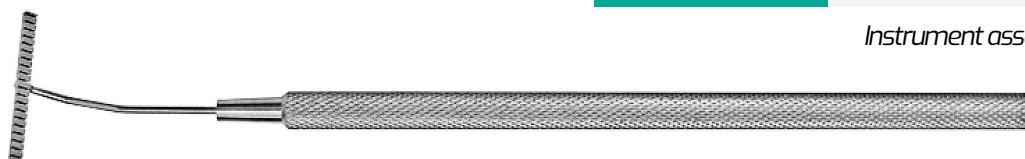

Instrument associé au Myomètre de Roth-Rapp

## Trépan

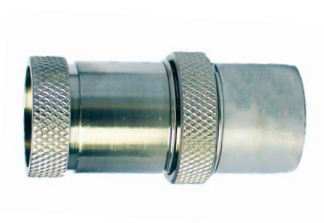

**A1.8165**

Trépan

16.5 mm

## Voies Lacrymales



**A8.4000**

Stylet dilatateur fin de Sichel Wilder



**A8.4010**

Stylet dilatateur moyen de Sichel Wilder



**A8.4020**

Stylet dilatateur fort de Sichel Wilder



**A8.4050**

Stylet dilatateur Double



**A8.4060**

Sonde à voie lacrymale



**A8.4110**

Sonde de Galezowski 000

∅ 0.6 mm



**A8.4120**

Sonde de Galezowski 00

∅ 0.7 mm



**A8.4130**

Sonde de Galezowski 0

∅ 0.8 mm



**A8.4140**

Sonde de Galezowski 1

∅ 0.9 mm



**A8.4150**

Sonde de Galezowski 2

∅ 1.0 mm



**A8.4160**

Sonde de Galezowski 3

∅ 1.1 mm



**A8.4170**

Sonde de Galezowski 4

∅ 1.2 mm



**A8.4180**

Sonde de Galezowski 5

∅ 1.4 mm

# BOITE CHIRURGICALE RETINE

## Boite de Chirurgie Rétine



①	<b>A1.1400</b>	Blépharostat de Castroviejo
②	<b>A3.3100</b>	Ciseaux de Castroviejo, mousse
③	<b>A2.6000</b>	Compas de Castroviejo
④	<b>A3.1210</b>	Ciseaux de Sevrins Stevens, courbes bout mousse
⑤	<b>A2.4060</b>	Crochet de Gass Rouchy
⑥	<b>A1.2210</b>	Ecarteur de Bonn, 10 cm
⑦	<b>A2.7710</b>	Marqueur scléral
⑧	<b>A6.7110</b>	Pince de Bonn
⑨	<b>A6.4000</b>	Pince de Halstead
⑩	<b>A6.8000</b>	Pince de Paufigue
⑪	<b>A6.4100 x 4</b>	Pinces puces
⑫	<b>A7.1110</b>	Porte-aiguille de Castroviejo
⑬	<b>A8.3005</b>	Boîte de stérilisation, plastique



## Boite de Chirurgie Paupière



①	<b>A3.1400</b>	<b>Ciseaux de Joseph droits</b> , pointu 14.5 cm
②	<b>A3.1210</b>	<b>Ciseaux de Sevrin Stevens</b> , courbe, bout mousse
③	<b>A2.4210 x 2</b>	<b>Crochets de Gillis</b> , petits
④	<b>A1.6000</b>	<b>Manche bistouri n°3</b>
⑤	<b>A6.3170</b>	<b>Pince d'Adson droite</b> , mors striés, sans griffe
⑥	<b>A6.4020 x 2</b>	<b>Pinces de Halstead courbes</b> , sans griffes, 11 cm
⑦	<b>A6.8060</b>	<b>Pince de Jayle</b> , 1x2 dents de 0.25mm
⑧	<b>A7.1010</b>	<b>Porte-aiguille de Castroviejo</b> , sans arrêt, courbe
⑨	<b>A7.1410</b>	<b>Porte-aiguille de Halsey</b> , mors en tungstène, 13cm
⑩	<b>A1.2014</b>	<b>Releveur de paupière de Desmarres</b> , 14mm
⑪	<b>A8.3005</b>	<b>Boite de stérilisation</b> , plastique

# BOITES CHIRURGICALES

## Boite Cataracte . Phaco / Micro.incisions

<b>A1.1030</b>	<b>Blépharostat pour phaco</b>
<b>A2.4510</b>	<b>Manipulateur d'Arneodo</b>
<b>A3.1010</b>	<b>Ciseaux de Bonn, courbe, mousse</b>
<b>A5.1341</b>	<b>Canule d'irrigation</b>
<b>A5.1460</b>	<b>Canule de Chazalon</b>
<b>A6.5110</b>	<b>Pince à monofilament de Troutman</b>
<b>A7.3010</b>	<b>Micro porte-aiguille de Barraquer Troutman</b>

## Boite Chalazion

<b>A1.2100</b>	<b>Plaque à paupière de Jaeger</b>
<b>A1.6000</b>	<b>Manche bistouri n°5</b>
<b>A2.1125</b>	<b>Curette à chalazion de Meyerhoefer</b>
<b>A3.1030</b>	<b>Ciseaux de Bonn, courbe, pointu</b>
<b>A6.2026</b>	<b>Pince à chalazion de Desmarres</b>
<b>A6.8050</b>	<b>Pince à sutures de Castroviejo</b>
<b>A7.1110</b>	<b>Porte-aiguille de Castroviejo</b>
<b>A8.3005</b>	<b>Boite de stérilisation, plastique</b>

## Boite à Enlever les fils

<b>A1.1020</b>	<b>Blépharostat de Barraquer Colibri</b>
<b>A5.2113</b>	<b>Canule de Rycroft</b>
<b>A6.4100</b>	<b>Pince puce</b>
<b>A6.7210</b>	<b>Pince de Barraquer Colibri</b>
<b>F1521MP</b>	<b>Micro-ciseaux de Vannas</b>

## Boite Enucléation / Eviscération

<b>A2.2200</b>	Curette à éviscération
<b>A2.4010</b>	Crochet à strabisme de Graefe
<b>A2.4060</b>	Crochet de Gass Rouchy
<b>A3.1010</b>	Ciseaux de Bonn, courbe, mousse
<b>A3.1020</b>	Ciseaux de Bonn, courbe, mousse
<b>A3.1300</b>	Ciseaux à énucléation
<b>A6.4100 x4</b>	Pince puce
<b>A6.5060</b>	Pince de Harms Tubingen
<b>A6.8000</b>	Pince de Paufique
<b>A7.1110</b>	Porte-aiguille de Castroviejo
<b>A8.3010</b>	Boite plastique
<b>F307E</b>	Blépharostat de Corcelle à vis

## Boite à Extraction des corps étrangers

<b>A1.1020</b>	Blépharostat de Barraquer Colibri
<b>A2.1115</b>	Curette à chalazion de Meyerhoefer
<b>A8.3003</b>	Boite de stérilisation, plastique

# BOITES CHIRURGICALES

## Boite à Glaucome

<b>A1.1100</b>	Blépharostat de Corcelle
<b>A1.3406</b>	Couteau cliveur de Paufique
<b>A1.5000</b>	Porte-lame de Troutman
<b>A1.5040</b>	Lames de rasoir
<b>A2.3401</b>	Spatule à iris de Culler
<b>A2.3500</b>	Spatule de Barraquer
<b>A3.4010</b>	Ciseaux de Vannas, courbe, mousse
<b>A3.4020</b>	Ciseaux de Vannas, courbe, mousse
<b>A5.2200</b>	Canule de Barraquer
<b>A6.5110</b>	Pince à monofilament de Troutman
<b>A6.6000</b>	Pince d'Alschmig à droit supérieur
<b>A6.7210</b>	Pince de Barraquer Colibri
<b>A6.8000</b>	Pince de Paufique
<b>A7.1100</b>	Porte-aiguille de Castroviejo
<b>A7.3110</b>	Porte-aiguille de Barraquer

## Boite à Ptérygion

<b>A1.3405</b>	Couteau cliveur de Paufique
<b>A1.3406</b>	Couteau de Paufique
<b>A1.6000</b>	Manche bistouri n°3
<b>A3.1030</b>	Ciseaux de Bonn, courbe, pointu
<b>A3.3000</b>	Ciseaux de Westcott, courbe, mousse
<b>A6.6210</b>	Pince d'Alschmig à droit supérieur
<b>A6.8000</b>	Pince de Paufique
<b>A6.8030</b>	Pince à sutures de Castroviejo
<b>A7.1110</b>	Porte-aiguille de Castroviejo

## Boite à Strabisme

<b>A1.1400</b>	Blépharostat de Castroviejo	<b>A6.8000</b>	Pince de Paufigue
<b>A1.2012</b>	Releveur à paupière de Desmarres	<b>A6.8030</b>	Pince à sutures de Castroviejo
<b>A2.4010</b>	Crochet à strabisme de Graefe	<b>A7.1110</b>	Porte-aiguille de Castroviejo
<b>A2.6000</b>	Compas de Castroviejo	<b>A7.3110</b>	Porte-aiguille de Barraquer
<b>A3.1210</b>	Ciseaux de Sevrin Stevens, courbe, mousse	<b>A8.3010</b>	Boîte de stérilisation, plastique
<b>A3.3000</b>	Ciseaux de Westcott, courbe, mousse	<b>F103C</b>	Pince de Blascovics
<b>A5.5000</b>	Canule de Galezowki	<b>F182A</b>	Réglette de Pechereau
<b>A6.4010</b>	Pince de Halsted	<b>F807C</b>	Myomètre de Roth-Rapp
<b>A6.4100 x2</b>	Pince puce	<b>F808A</b>	Crochet de Hugonnier

## Boite Voies Lacrymales

<b>A5.5000</b>	Canule de Galezowki
<b>A5.5200</b>	Canule de Galezowki
<b>A8.4000</b>	Stylet dilatateur de Sichel Wilder
<b>A8.4010</b>	Stylet dilatateur de Sichel Wilder
<b>A8.4050</b>	Stylet dilatateur de Sichel Wilder
<b>A8.4120</b>	Sonde de Galezowski
<b>A8.4130</b>	Sonde de Galezowski
<b>A8.4140</b>	Sonde de Galezowski
<b>A8.4150</b>	Sonde de Galezowski

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES INSTRUMENTS CHIRURGICAUX FCI®

**Les instruments chirurgicaux FCI® sont livrés NON STERILES.**

**ILS DOIVENT ETRE DECONTAMINES, NETTOYES ET STERILISES AVANT CHAQUE UTILISATION.**

Les recommandations pour l'entretien de nos instruments de chirurgie en acier inoxydable et en titane sont les suivantes :

### Rinçage :

- ◆ Ne pas laisser sécher de sang ou de tissu sur l'instrument
- ◆ Rincer l'instrument immédiatement après chaque utilisation avec de l'eau déminéralisée ou distillée

### Décontamination :

- ◆ Tremper l'instrument dans un bain décontaminant préparé selon les recommandations du fournisseur
- ◆ Nous déconseillons l'utilisation de l'hypochlorite de sodium, ce décontaminant étant corrosif vis.à.vis de l'acier inoxydable

### Inactivation chimique des Agents Transmissibles Non Conventionnels :

- ◆ Nous recommandons l'utilisation d'une solution de soude 1N, préparée avec de l'eau déminéralisée, par trempage pendant 60 minutes à 20°C / 66°F. Cette inactivation doit être suivie d'un rinçage très soigneux jusqu'à ce que le pH du bain soit neutre. La présence de résidus de soude sur les instruments lors de la stérilisation est tenue responsable d'une corrosion importante. La présence d'ions chlorures dans les eaux de ville rend la solution de soude corrosive, d'où la nécessité d'utiliser de l'eau déminéralisée
- ◆ Rincer soigneusement l'instrument avec de l'eau déminéralisée

### Nettoyage :

- ◆ Nettoyer l'instrument selon l'un de ces procédés :
  - ◇ Avec une solution savonneuse et une brosse à poils souples
  - ◇ Par un passage d'au moins 5 minutes au bas à ultrasons
  - ◇ En machine à laver
- ◆ Sécher l'instrument rapidement et parfaitement

### Stérilisation (inactivation physique des Agents Transmissibles Non Conventionnels) :

- ◆ Stériliser l'instrument à l'autoclave selon un cycle validé (les paramètres recommandés sont 18 minutes à 134°C / 293°F, sous une pression de 2 bars)
- ◆ Veiller à utiliser une boîte adaptée à ce mode de stérilisation

### Conseils pratiques :

- ◆ Traiter séparément les instruments fabriqués à partir de métaux différents
- ◆ Ne pas mélanger les instruments en bon état avec d'autres corrodés ou abîmés
- ◆ Vérifier les fonctions et la propreté de chaque instrument après nettoyage

# INDEX ALPHANUMERIQUE

REFERENCE / DENOMINATION / PAGE

<b>A1.1000</b>	Blépharostat de Barraquer Colibri	p.2	<b>A2.4120</b>	Crochet d'Arruga	p.21
<b>A1.1010</b>	Blépharostat de Barraquer Colibri	p.2	<b>A2.4200</b>	Crochet de Gillis	p.20
<b>A1.1020</b>	Blépharostat de Barraquer Colibri	p.2	<b>A2.4210</b>	Crochet de Gillis	p.20
<b>A1.1030</b>	Blépharostat de Kratz	p.2	<b>A2.4220</b>	Double crochet de Ferron	p.20
<b>A1.1100</b>	Blépharostat de Corcelle	p.3	<b>A2.4300</b>	Micro.crochet à iris de Bonn	p.18
<b>A1.1400</b>	Blépharostat de Castroviejo	p.3	<b>A2.4320</b>	Crochet bouton de col	p.18
<b>A1.2010</b>	Releveur à paupière de Desmarres	p.41	<b>A2.4400</b>	Crochet de Sinskey	p.18
<b>A1.2012</b>	Releveur à paupière de Desmarres	p.41	<b>A2.4410</b>	Crochet de Sinskey - Cornic	p.18
<b>A1.2014</b>	Releveur à paupière de Desmarres	p.41	<b>A2.4500</b>	Crochet de Jaefe Bechert	p.19
<b>A1.2100</b>	Plaque à paupière de Jaeger	p.37	<b>A2.4510</b>	Manipulateur d'Arneodo	p.19
<b>A1.2210</b>	Ecarteur de Bonn	p.24	<b>A2.4511</b>	Manipulateur d'Arneodo Vachet	p.19
<b>A1.2300</b>	Ecarteur de Wolkman	p.24	<b>A2.4520</b>	Manipulateur de Lebuison	p.19
<b>A1.2350</b>	Réglette en demi mm	p.40	<b>A2.4550</b>	Phaco.Chopper	p.19
<b>A1.3405</b>	Couteau cliveur de Paufigue	p.17	<b>A2.4700</b>	Anse de Lester	p.18
<b>A1.3406</b>	Couteau cliveur de Paufigue	p.17	<b>A2.5000</b>	Anse de Snellen	p.1
<b>A1.4000</b>	Aiguille à corps étrangers	p.1	<b>A2.5100</b>	Anse irrigatrice de Pearce	p.1
<b>A1.5000</b>	Porte.lame de Troutman	p.40	<b>A2.6020</b>	Compas de Sourdille	p.17
<b>A1.5040</b>	Lames de rasoir	p.40	<b>A2.7710</b>	Marqueur pour le DR	p.24
<b>A1.6000</b>	Manche bistouri n°3	p.40	<b>A3.1000</b>	Ciseaux de Bonn	p.14
<b>A1.8165</b>	Trépan 16,5 mm	p.42	<b>A3.1010</b>	Ciseaux de Bonn	p.14
<b>A2.1101</b>	Curette à VL de J.A. Bernard	p.23	<b>A3.1020</b>	Ciseaux de Bonn	p.14
<b>A2.1115</b>	Curette à chalazion de Meyerhoefer	p.23	<b>A3.1030</b>	Ciseaux de Bonn	p.14
<b>A2.1120</b>	Curette à chalazion de Meyerhoefer	p.23	<b>A3.1100</b>	Ciseaux d'Ophtalmologie	p.15
<b>A2.1125</b>	Curette à chalazion de Meyerhoefer	p.23	<b>A3.1110</b>	Ciseaux d'Ophtalmologie	p.15
<b>A2.1135</b>	Curette à chalazion de Meyerhoefer	p.23	<b>A3.1120</b>	Ciseaux d'Ophtalmologie	p.15
<b>A2.2200</b>	Curette à éviscération	p.23	<b>A3.1130</b>	Ciseaux d'Ophtalmologie	p.15
<b>A2.3401</b>	Spatule à iris de Culler	p.42	<b>A3.1200</b>	Ciseaux de Sevrin Stevens	p.16
<b>A2.3500</b>	Spatule de Barraquer	p.42	<b>A3.1210</b>	Ciseaux de Sevrin Stevens	p.16
<b>A2.3600</b>	Spatule de Cornic	p.42	<b>A3.1220</b>	Ciseaux de Sevrin Stevens	p.16
<b>A2.3720</b>	Bissecteur de Teyssier	p.42	<b>A3.1230</b>	Ciseaux de Sevrin Stevens	p.16
<b>A2.4010</b>	Crochet à strabisme de Graefe	p.21	<b>A3.1300</b>	Ciseaux à énucléation	p.13
<b>A2.4060</b>	Crochet de Gass Rouchy	p.21	<b>A3.2000</b>	Ciseaux à iridectomie de Wecker	p.13
<b>A2.4070</b>	Crochet à DR	p.21	<b>A3.2010</b>	Ciseaux à iridectomie Barraquer	p.13
<b>A2.4110</b>	Crochet d'Arruga	p.21	<b>A3.3000</b>	Ciseaux de Westcott	p.17
			<b>A3.3100</b>	Ciseaux de Castroviejo	p.12

# INDEX ALPHANUMERIQUE

<b>A3.3110</b>	Ciseaux de Castroviejo	p.12	<b>A5.2000</b>	Canule pour le healon	p.7
<b>A3.3250</b>	Ciseaux de Katzin à lames inversées	p.12	<b>A5.2113</b>	Canule de Rycroft	p.7
<b>A3.3260</b>	Ciseaux de Katzin à lames inversées	p.12	<b>A5.2114</b>	Canule de Rycroft	p.7
<b>A3.3270</b>	Ciseaux de Katzin à lames inversées	p.12	<b>A5.2200</b>	Canule de Barraquer	p.7
<b>A3.3280</b>	Ciseaux de Katzin à lames inversées	p.12	<b>A5.4100</b>	Canule gratteuse	p.7
<b>A3.4000</b>	Ciseaux de Vannas	p.11	<b>A5.4200</b>	Canule de Charleux gratteuse	p.7
<b>A3.4010</b>	Ciseaux de Vannas	p.11	<b>A5.4300</b>	Canule de Kratz gratteuse	p.8
<b>A3.4020</b>	Ciseaux de Vannas	p.11	<b>A5.5000</b>	Canule de Galezowki	p.10
<b>A3.4030</b>	Ciseaux de Vannas	p.11	<b>A5.5200</b>	Canule de Galezowki	p.10
<b>A4.1400</b>	Marqueur de Hoffer	p.24	<b>A6.1300</b>	Pince de Kelman Mac Pherson	p.25
<b>A4.1400</b>	Marqueur optique de Hoffer	p.24	<b>A6.1500</b>	Pince d'Utrata	p.26
<b>A5.1000</b>	Canule de Charleux	p.6	<b>A6.1510</b>	Pince d'Utrata courbe	p.26
<b>A5.1010</b>	Canule de Charleux	p.6	<b>A6.1520</b>	Pince de Corydon	p.25
<b>A5.1015</b>	Canule de Charleux	p.6	<b>A6.1530</b>	Pince de Corydon	p.25
<b>A5.1020</b>	Canule de Charleux	p.6	<b>A6.1540</b>	Pince d'Utrata	p.26
<b>A5.1050</b>	Canule de Simcoe	p.6	<b>A6.1550</b>	Pince d'Utrata	p.26
<b>A5.1100</b>	Canule de Binkhorst	p.6	<b>A6.2020</b>	Pince à chalazion de Desmarres	p.27
<b>A5.1110</b>	Canule de Binkhorst à gauche	p.6	<b>A6.2026</b>	Pince à chalazion de Desmarres	p.27
<b>A5.1120</b>	Canule de Binkhorst à droite	p.6	<b>A6.3000</b>	Pince à cils de Barraquer	p.28
<b>A5.1213</b>	Canule THX double courant	p.8	<b>A6.3100</b>	Pince à disséquer	p.30
<b>A5.1222</b>	Canule THX double courant	p.8	<b>A6.3120</b>	Pince à disséquer	p.30
<b>A5.1234</b>	Canule THX double courant	p.8	<b>A6.3150</b>	Pince d'Adson Brown	p.30
<b>A5.1235</b>	Canule THX Teyssier	p.8	<b>A6.3160</b>	Pince d'Adson	p.30
<b>A5.1240</b>	Canule THX Teyssier	p.8	<b>A6.3170</b>	Pince d'Adson droite	p.30
<b>A5.1300</b>	Canule double courant de Simcoe inversée	p.8	<b>A6.4000</b>	Pince de Halsted	p.32
<b>A5.1341</b>	Canule d'irrigation	p.6	<b>A6.4010</b>	Pince de Halsted	p.32
<b>A5.1342</b>	Canule d'irrigation	p.6	<b>A6.4020</b>	Pince de Halsted	p.32
<b>A5.1343</b>	Canule de Guerin	p.7	<b>A6.4100</b>	Pince puce	p.32
<b>A5.1344</b>	Canule de Guerin	p.7	<b>A6.4200</b>	Pince à champs	p.35
<b>A5.1350</b>	Canule double courant de Simcoe originale	p.9	<b>A6.5060</b>	Pince de Harms Tubingen	p.34
<b>A5.1400</b>	Canule THX double courant "club de golf"	p.9	<b>A6.5100</b>	Pince à monofilament de Troutman	p.34
<b>A5.1410</b>	Canule THX double courant "club de golf"	p.9	<b>A6.5110</b>	Pince à monofilament de Troutman	p.34
<b>A5.1450</b>	Tube silicone	p.9	<b>A6.5120</b>	Pince à monofilament	p.34
<b>A5.1460</b>	Canule de chalazon	p.7	<b>A6.5130</b>	Pince à monofilament	p.34
<b>A5.1465</b>	Canule de Chalazon	p.7	<b>A6.5150</b>	Pince Colibri	p.29
<b>A5.1470</b>	Canule pour Lasik	p.10	<b>A6.6000</b>	Pince d'Elschnig à droit supérieur	p.31
<b>A5.1500</b>	Canule THX modifiée Laforge	p.9			
<b>A5.1600</b>	Canule pour hydrodissection	p.7			



# INDEX ALPHANUMERIQUE

REFERENCE / DENOMINATION / PAGE

<b>A6.6010</b>	Pince d'Elschnig à droit supérieur	p.31	<b>A8.4010</b>	Stylet dilatateur de Sichel Wilder	p.43
<b>A6.6210</b>	Pince d'Elschnig à droit supérieur	p.31	<b>A8.4020</b>	Stylet dilatateur de Sichel Wilder	p.43
<b>A6.7100</b>	Pince de Bonn	p.28	<b>A8.4050</b>	Stylet dilatateur double	p.43
<b>A6.7110</b>	Pince de Bonn	p.28	<b>A8.4050</b>	Sonde de Galezowski	p.43
<b>A6.7130</b>	Pince de Bonn	p.28	<b>A8.4110</b>	Sonde de Galezowski	p.43
<b>A6.7140</b>	Pince de Bonn	p.28	<b>A8.4120</b>	Sonde de Galezowski	p.43
<b>A6.7200</b>	Pince de Barraquer Colibri	p.29	<b>A8.4130</b>	Sonde de Galezowski	p.43
<b>A6.7210</b>	Pince de Barraquer Colibri	p.29	<b>A8.4140</b>	Sonde de Galezowski	p.43
<b>A6.8000</b>	Pince de Paufique	p.36	<b>A8.4150</b>	Sonde de Galezowski	p.43
<b>A6.8012</b>	Pince à sutures de Castroviejo	p.36	<b>A8.4160</b>	Sonde de Galezowski	p.43
<b>A6.8030</b>	Pince à sutures de Castroviejo	p.36	<b>A8.4170</b>	Sonde de Galezowski	p.43
<b>A6.8050</b>	Pince à sutures de Castroviejo	p.36	<b>A8.4180</b>	Sonde de Galezowski	p.43
<b>A6.8060</b>	Pince de Jayle	p.36	<b>A9.1000</b>	Rongeur de Kerrison	p.41
<b>A6.9000</b>	Pince de Cornic	p.34	<b>A9.2100</b>	Ecarteur de Knapp	p.24
<b>A6.9160</b>	Pince à saisir les implants souples	p.33	<b>F101B</b>	Pince à chalazion du Dr Sgard	p.27
<b>A7.1000</b>	Porte.aiguille de Castroviejo	p.37	<b>F103C</b>	Pince de Blascovics	p.35
<b>A7.1010</b>	Porte.aiguille de Castroviejo	p.37	<b>F127B</b>	Pince de Mermoud	p.31
<b>A7.1100</b>	Porte.aiguille de Castroviejo	p.37	<b>F142D</b>	Pince à mouvements croisés du Dr Zaluski	p.26
<b>A7.1110</b>	Porte.aiguille de Castroviejo	p.37	<b>F142M</b>	Pince capsulorhexis de Corydon	p.25
<b>A7.1120</b>	Porte.aiguille de Castroviejo à arrêt	p.38	<b>F142MI</b>	Pince capsulorhexis micro.incision	p.26
<b>A7.1130</b>	Porte.aiguille de Castroviejo à arrêt	p.38	<b>F142U</b>	Pince Utrata, mouvements croisés, Dr Zaluski	p.27
<b>A7.1200</b>	Porte.aiguille gros manche	p.38	<b>F145C</b>	Pince de Mac Pherson	p.25
<b>A7.1400</b>	Porte.aiguille de Halsey	p.38	<b>F1520P</b>	Micro.ciseaux de Vannas droit	p.11
<b>A7.1410</b>	Porte.aiguille de Halsey	p.38	<b>F1521MP</b>	Micro.ciseaux de Vannas	p.11
<b>A7.2010</b>	Micro porte.aiguille de Castroviejo	p.38	<b>F182A</b>	Réglette/Spatule de Pechereau	p.40 / p.42
<b>A7.3010</b>	Micro porte.aiguille Barraquer Troutman	p.39	<b>F307C</b>	Blépharostat de Corcelle à vis	p.3
<b>A7.3100</b>	Porte.aiguille de Barraquer	p.39	<b>F307E</b>	Blépharostat Colibri réglable	p.3
<b>A7.3110</b>	Porte.aiguille de Barraquer	p.39	<b>F804A</b>	Micro.manipulateur de Clayman	p.19
<b>A7.3130</b>	Porte.aiguille de Barraquer à arrêt	p.39	<b>F805B</b>	Micro.manipulateur de Buratto	p.19
<b>A7.3200</b>	Micro porte.aiguille de Cornic	p.39	<b>F807B</b>	Crochet de Green.Malbran	p.21
<b>A7.3210</b>	Micro porte.aiguille de Cornic	p.39	<b>F807C</b>	Myomètre de Roth.Rapp	p.22
<b>A8.3000</b>	Boite plastique	p.4	<b>F808A</b>	Crochet de Hugonnier	p.21
<b>A8.3003</b>	Boite plastique	p.4	<b>F810A</b>	Crochet à strabisme petit	p.22
<b>A8.3005</b>	Boite plastique	p.5	<b>F811A</b>	Crochet à strabisme petit	p.22
<b>A8.3010</b>	Boite plastique	p.5	<b>F903A</b>	Micro.manipulateur de Buratto	p.18
<b>A8.4000</b>	Stylet dilatateur de Sichel Wilder	p.43	<b>S5.3100</b>	Pince de Watzke pour rétine	p.27

# CONDITIONS GENERALES DE VENTE

## GÉNÉRALITÉS

Les prix et renseignements portés sur les catalogues, prospectus et tarifs sont donnés à titre indicatif.

La Société se réserve le droit d'apporter toutes modifications de présentation de forme, de dimension, de conception ou matières à ses produits dont les gravures et les descriptions figurent sur les imprimés de publicité. La Société n'est liée par les engagements qui pourraient être pris par ses représentants ou employés que sous réserve de confirmation écrite par elle-même des dits engagements.

Les propositions faites par la Société sont remises à titre indicatif, aucune réception de fonds préalable à la vente ne peut constituer engagement. L'acceptation des offres implique l'adhésion aux présentes conditions, sauf cas de stipulations contraires précises incluses dans les textes des acceptations de commande.

Pour être admises, les réclamations sur la composition, la quantité et les poids des produits livrés ou leur non-conformité avec le bordereau d'expédition doivent être formulées par lettre recommandée avec avis de réception dans les huit jours de l'arrivée de la marchandise sans préjudice des dispositions à prendre à l'égard du transporteur.

Les fournitures additionnelles à la commande feront l'objet d'un nouveau contrat de vente mentionnant les prix, conditions, délais, etc. qui les concernent.

## LIVRAISON . TRANSPORT . PRIX

La livraison est effectuée soit par la remise directe des marchandises au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par la délivrance dans les usines ou magasin de la Société à un expéditeur ou un transporteur.

Les marchandises de la Société voyagent aux risques et périls du client, même en cas de retour ou d'un envoi franco de port ou contre remboursement.

La Société ne peut être tenue responsable des dommages survenus au cours du transport.

En conséquence, il appartient au client de procéder à la vérification quantitative et qualitative des produits à leur réception. Les réserves précisant le type de dommage et son importance doivent être faites sur le récépissé du transporteur et confirmées à celui-ci (par lettre recommandée avec avis de réception) dans les trois jours francs suivant la réception (article 105 du Code de Commerce). Ces précautions permettent au transporteur seul responsable d'entreprendre une action auprès de son assurance.

Les conditionnements ne sont jamais fractionnés et sont facturés en boitage standard.

**Pour toute commande inférieure à 220 Euros hors taxes (deux cent vingt euros), une participation forfaitaire aux frais de port, d'un montant de 6€, sera à la charge de l'acheteur.**

**Les commandes égales ou supérieures à 220 Euros hors taxes (deux cent vingt euros) sont expédiées franco de port.**

**Les commandes sont facturées selon le tarif en vigueur à la date de commande.**

## DELAI DE LIVRAISON

Si la livraison est retardée sur la demande de l'acheteur ou pour une cause quelconque indépendante de la volonté de la Société, et si la Société y consent, les produits sont emmagasinés, s'il y a lieu, aux frais et risques de l'acheteur, la Société déclinant toute responsabilité consécutive à ce retard.

Ces dispositions ne modifient en rien les obligations de paiement de la fourniture et ne constituent pas novation.

Les délais de livraison sont maintenus dans la limite du possible, mais ces délais étant donnés à titre indicatif, les retards ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation de la commande ni l'octroi d'une indemnité.

La Société est déchargée, de plein droit, de tout engagement relatif aux délais de livraison :

Dans le cas où les conditions de paiement n'auraient pas été observées par l'acheteur,

Dans le cas où les renseignements à fournir, par l'acheteur, ne seraient pas parvenus en temps voulu,

En cas de force majeure ou d'événements tels que black out, grève, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accident d'outillages, rebuts de pièces importantes en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause amenant un chômage total ou partiel pour le fabricant ou ses fournisseurs.

La Société, dans toute la mesure de ses moyens, tiendra l'acheteur au courant, en temps opportun, des cas ou événements ci-dessus énumérés.

## RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

La marchandise reste la propriété de la Société jusqu'au paiement complet, lors de la remise des traites ou des chèques jusqu'à leur encaissement. Des dispositions spéciales comme par exemple la mise en gage, transmission d'assurance ou autres ne sont uniquement autorisées qu'après l'accord écrit de la Société.

En cas de vente de la marchandise, le nouvel acquéreur est redevable à la Société jusqu'à l'exécution du paiement et jusqu'à concurrence du montant dû.

## PAIEMENT

**Les factures sont payables à la date d'échéance prévue sur chacune d'elles en conformité avec le délai règlement accordé par FCI SAS. Conformément à l'article L 441.6 du code de commerce en cas de retard de règlement des pénalités seront appliquées. Le taux des pénalités est égal à trois fois le taux d'intérêt légal soit au 01 janvier 2013 un taux de 2.13 %. Il sera également appliqué une indemnité forfaitaire pour frais recouvrement d'un montant de 40 € par facture.**

## CLAUSE RÉSOLUTOIRE

La vente sera résiliée de plein droit si bon semble à la Société, en cas de non-paiement dans le délai fixé soit de la totalité, soit d'une partie ou du solde du prix à l'une des échéances convenues.

Dès réception d'une lettre recommandée de la Société se prévalant de ladite clause, l'acheteur devra immédiatement leur remettre les marchandises se trouvant encore en sa possession.

Si la Société est amenée à faire jouer cette clause résolutoire et donc à reprendre les marchandises vendues, les acomptes perçus lui resteront définitivement acquis comme indemnité forfaitaire à titre de clause pénale sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

## CONTESTATIONS

En cas de contestation à quelque titre que ce soit, le client accepte d'avance la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de PARIS. L'acceptation de traite ou de tout autre document n'apporte ni novation, ni dérogation à cette attribution de juridiction.

## CONDITIONS PARTICULIÈRES

S'il n'y a pas identité absolue entre les conditions générales exposées ci-dessus et les conditions particulières de la Société, il est expressément stipulé que les clauses particulières de la Société ont primauté sur celles des conditions générales qui ne sont pas conformes.



Avant toute utilisation d'un dispositif médical,  
FCI vous invite à lire attentivement les instructions  
figurant dans la notice qui l'accompagne.

FCI18/016 Ind A - Mai 2018 - Société par actions simplifiées au capital de 46 909 € - SIREN 351 670 385 - RCS PARIS



**FCI S.A.S.**

20 / 22 Rue Louis Armand - 75015 Paris - France

Tél : 01 53 98 98 98

Fax : 01 53 98 98 99

fci@fci.fr / www.fci.fr