




# Catalogue Instrumentation Restérilisable

[www.fci.fr](http://www.fci.fr)

CATALOGUE DE VENTE 2018



**FCI**®



# SOMMAIRE

## PAR ORDRE ALPHABETIQUE

Aiguille à corps étrangers	p.1	Pincés	p.25
Anses	p.1	Capsulaires	p.25
Blépharostat	p.2	A capsulorhexis	p.25
Boites de stérilisation	p.4	Chalazion	p.27
Canules	p.6	A cils	p.27
Cataracte	p.6	Cornée	p.28
Double courant	p.8	A disséquer	p.30
Voies lacrymales	p.10	Eviscération / Enucléation	p.31
Lasik	p.10	A fixer	p.31
Ciseaux	p.11	A glaucome	p.31
A cornée	p.11	Hémostatiques	p.32
D'enucléation	p.13	A implants	p.33
D'explantation	p.13	A monofilament	p.34
A iris	p.13	Rétine	p.35
D'ophtalmologie	p.14	A strabisme	p.35
Ténotomie	p.16	A suture	p.36
Couteaux	p.17	Divers	p.36
Compas	p.17	Plaqué à paupière	p.37
Crochets	p.18	Porte-aiguilles	p.37
A implantation	p.18	Porte-lames	p.40
A phaco	p.19	Réglettes	p.40
A paupière	p.20	Releveurs	p.41
A strabisme	p.21	Rongeur	p.41
Curettes	p.23	Spatules	p.42
Ecarteurs	p.24	Trépan	p.42
Marqueurs	p.24	Voies lacrymales	p.43
		Boites chirurgicales	p.44
		Index alphanumérique	p.53
		Conditions générales de vente	p.56



## Aiguille à corps étranger

**A1.4000**

Aiguille à corps étrangers

13 cm




## Anses

**A2.5000**

Anse de Snellen

14 cm



**A2.5100**

Anse irrigatrice de Pearce

*Injection d'air et de liquide*

## Blépharostats



**A1.1000**

Blépharostat de Barraquer Colibri 5mm

*Nourisson*



**A1.1010**

Blépharostat de Barraquer Colibri 10mm

*Enfant*



**A1.1020**


Blépharostat de Barraquer Colibri 15mm

*Adulte*



**A1.1030**

Blépharostat de Kratz (phaco)

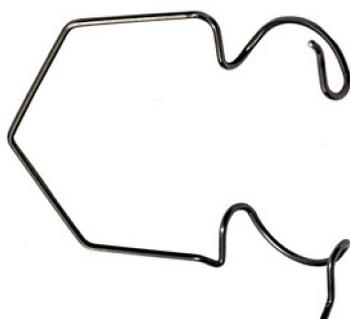

**F304B**

Blépharostat de Kratz (temporale)



**A1.1100**

Blépharostat de Corcelle



**A1.1400**

Blépharostat de Castroviejo à vis



**F307B**

Blépharostat pour LASIK



**F307E**

Blépharostat Colibri réglable


*Oreilles ouvertes, extrémité olivaire*

## Boîtes de stérilisation

**A8.3000**

Boite Plastique — Petite


160 x 70 x 20 mm

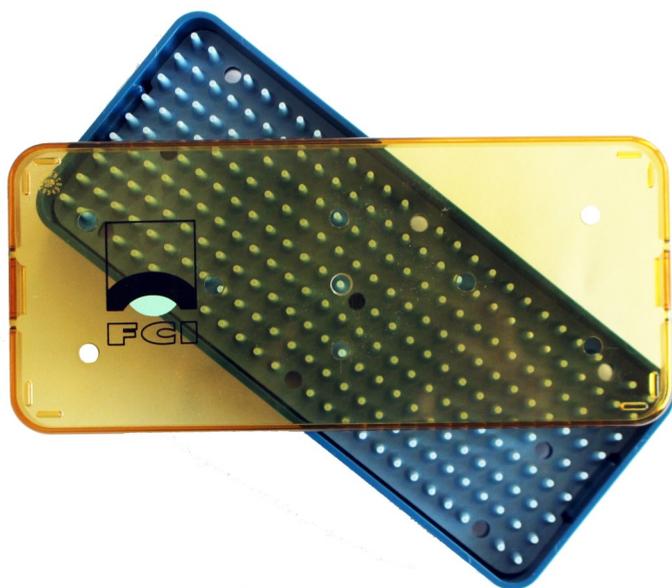

**A8.3003**

Boite Plastique — Moyenne

170 x 108 x 20 mm

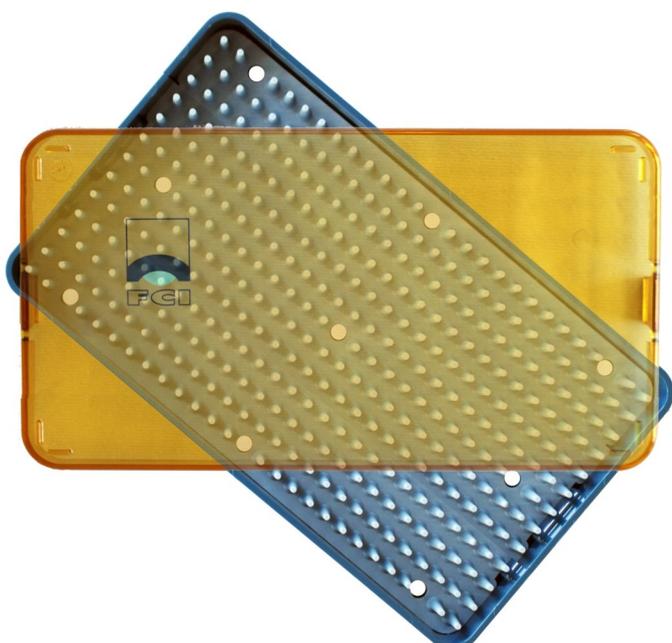


# BOITES DE STERILISATION

**A8.3005**

Boite Plastique — Grande


260 x 160 x 20 mm

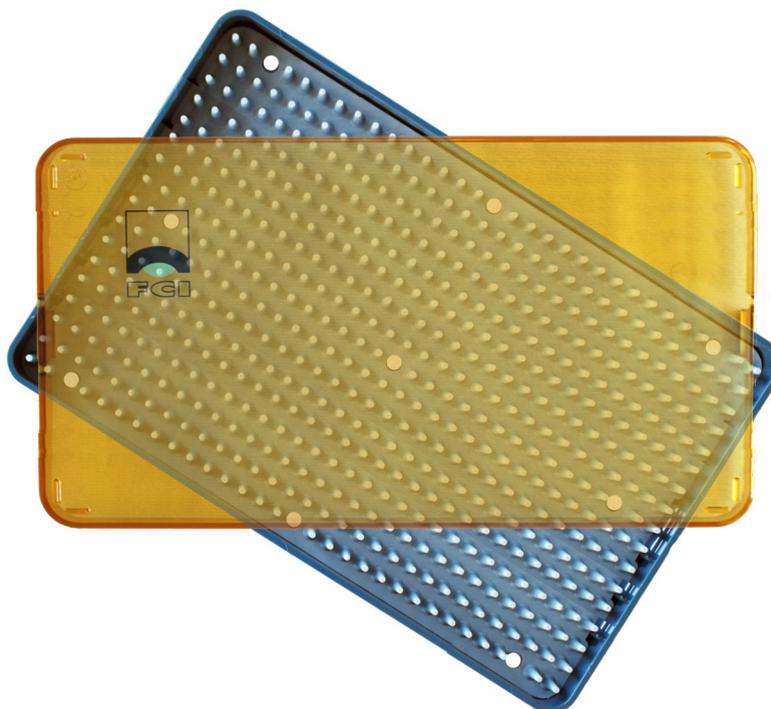


**A8.3010**

Boite Plastique à deux étages — Grande

260 x 160 x 20 mm

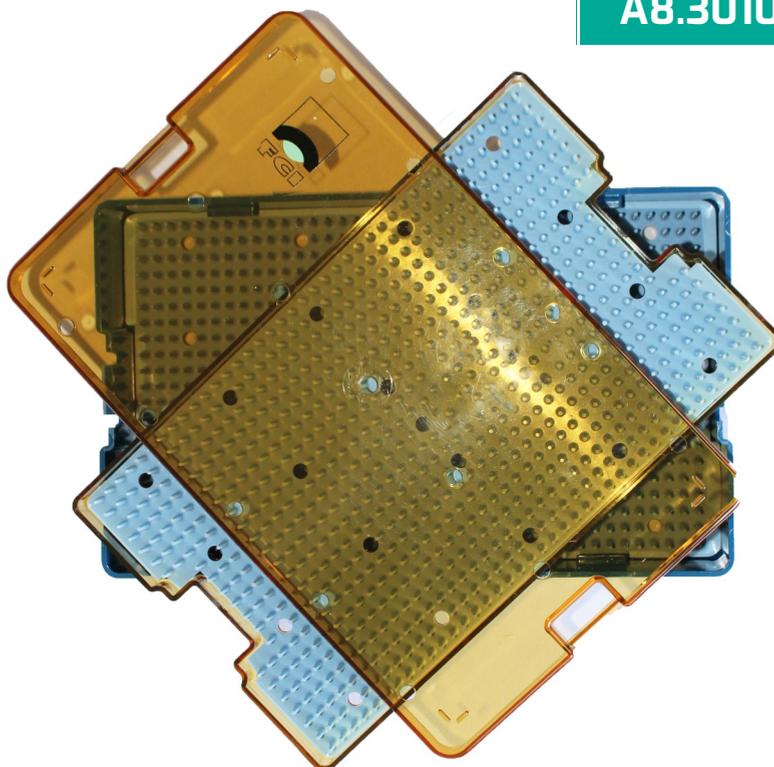

## Cataracte



**A5.1000**

Canule de Charleux 13 mm  $\varnothing$  0.6 mm


**A5.1010**

Canule de Charleux 13 mm  $\varnothing$  0.5 mm

**A5.1015**

Canule de Charleux 13 mm  $\varnothing$  0.4 mm


*Aspiratrice du cortex (cataracte)*



**A5.1020**

Canule de Charleux 20 mm  $\varnothing$  0.6 mm


*Aspiratrice du cortex (cataracte)*



**A5.1050**

Canule de Simcoe  $\varnothing$  0.3 mm


*Aspiratrice du cortex (cataracte)*



**A5.1100**

Canule de Binkhorst en crochet


$\varnothing$  extérieur 0.6 mm



**A5.1110**

Canule de Binkhorst en crochet


*Aspiratrice du cortex (cataracte), coudée à gauche*



**A5.1120**

Canule de Binkhorst en crochet


*Aspiratrice du cortex (cataracte), coudée à droite*



**A5.1341**

Canule d'irrigation  $\varnothing$  1.0 mm


*Injection d'air et de liquide*



**A5.1342**

Canule d'irrigation  $\varnothing$  0.6 mm


*Injection d'air et de liquide*



**A5.1343**

Canule de Guerin


*Nettoyage de la face postérieure de la capsule antérieure*



**A5.1344**

Canule de Guerin

*Nettoyage de la face postérieure de la capsule antérieure à midi*




**A5.1460**

Canule de Chazalon

**A5.1465**


Canule de Chazalon pour gaucher

*Aspiratrice du cortex (cataracte)*



**A5.1600**


Canule pour hydrodissection  $\varnothing$  0.4 mm



**A5.2000**

Canule pour le healon

*Coudée à 10 mm,  $\varnothing$  0.5 mm*



**A5.2113**

Canule de Rycroft


$\varnothing$  0.3 mm

**A5.2114**

Canule de Rycroft

$\varnothing$  0.4 mm

*Injection d'air*




**A5.2200**

Canule de Barraquer

$\varnothing$  0.4 mm


*Cyclodialyse, courbe à bout olivaire*



**A5.4100**


Canule de Simcoe gratteuse

$\varnothing$  0.5 mm



**A5.4200**


Canule de Charleux Gratteuse



**A5.4300**

Canule de Kratz Gratteuse

## Double courant



**A5.1213**


Canule THX double courant  $\varnothing 0.3\text{ mm}$

**A5.1222**

Canule THX double courant  $\varnothing 0.2\text{ mm}$


**A5.1234**

Canule THX double courant  $\varnothing 0.4\text{ mm}$




**A5.1235**

Canule THX Teyssier  $\varnothing 0.6\text{ mm}$




**A5.1240**

Canule THX modifiée Turut  $\varnothing 0.6\text{ mm}$



**A5.1300**


Canule double courant de Simcoe inversée  
 $\varnothing 0.3\text{ mm}$



**A5.1350**

Canule double courant de Simcoe originale


Ø 0.3 mm



**A5.1400**

Canule THX double courant « Club de golf »


Trou d'aspiration latéral, Ø 0.3 mm



**A5.1410**

Canule THX double courant « Club de golf »

Trou d'aspiration distal



**A5.1500**

Canule THX modifiée Laforge

Ø extérieur 1.5 mm



**A5.1450**

Tube silicone

1 mètre

## Voies Lacrymales



**A5.5000**

Canule de Galezowski

*Droite, 14 mm*



**A5.5200**

Canule de Galezowski

*Droite, 18 mm*

## Lasik



**A5.1470**

Canule pour Lasik

## à Cornée

**A3.4000**

Ciseaux de Vannas

*Lames 8 mm, droit, mousse*



**A3.4010**

Ciseaux de Vannas


*Lames 8 mm, courbe, mousse*



**F1520P**

Micro-ciseaux de Vannas

*Lames 8 mm, droit, pointu*

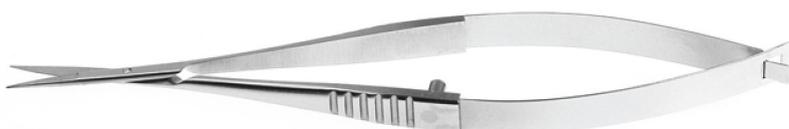

**F1521MP**

Micro-ciseaux de Vannas

*Lames 7 mm, courbe, pointu*



**A3.4020**

Micro-ciseaux de Vannas

*Lames 5 mm, droit, mousse*



**A3.4030**

Micro-ciseaux de Vannas

*Lames 5 mm, courbe, mousse*



**A3.3100**

Ciseaux de Castroviejo

*Lames 11 mm, courbe, mousse*



**A3.3110**

Ciseaux de Castroviejo

*Lames 9 mm, courbe, mousse*



**A3.3250**

Ciseaux de Katzin à lames inversées

*Lames 11.5 mm, mousse, à droite*



**A3.3260**

Ciseaux de Katzin à lames inversées

*Lames 11.5 mm, mousse, à gauche*



**A3.3270**

Micro-ciseaux de Katzin à lames inversées

*Lames 9.5 mm, mousse, à droite*



**A3.3280**

Micro-ciseaux de Katzin à lames inversées

*Lames 9.5 mm, mousse, à gauche*



**A3.5000**

Ciseaux à capsule de Cornic

*Lames fines 13 mm, courbe, pointu*



## d'Énucléation

**A3.1300**

Ciseaux à énucléation



## d'Explantation

**F1520I**

Micro-ciseaux coupe implants du Dr Jadé

*Droit, pointu*



## à Iris

**A3.2000**

Ciseaux à iridectomie de Wecker

*Lames 8 mm, mousse*



**A3.2010**

Ciseaux à iridectomie de Barraquer

*Lames 7 mm, mousse*





**A3.1000**

Ciseaux de Bonn

*9 cm, lames 15mm, droit, mousse*



**A3.1010**

Ciseaux de Bonn

*9 cm, lames 15 mm, courbe, mousse*



**A3.1020**

Ciseaux de Bonn

*9 cm, lames 15 mm, droit, pointu*



**A3.1030**

Ciseaux de Bonn

*9 cm, lames 15 mm, courbe, pointu*

**A3.1100**

Ciseaux d'Ophtalmologie

*10.5 cm, lames 27 mm, droit, mousse*



**A3.1110**

Ciseaux d'Ophtalmologie

*10.5 cm, lames 27 mm, courbe, mousse*



**A3.1120**

Ciseaux d'Ophtalmologie

*10.5 cm, lames 28 mm, droit, pointu*



**A3.1130**

Ciseaux d'Ophtalmologie

*10.5 cm, lames 28 mm, courbe, pointu*



## à Ténotomie



**A3.1200**

Ciseaux de Sevrin Stevens

*9,5 cm, droit, mousse*



**A3.1210**

Ciseaux de Sevrin Stevens

*9,5 cm, courbe, mousse*



**A3.1220**

Ciseaux de Sevrin Stevens

*9,5 cm, droit, pointu*



**A3.1230**

Ciseaux de Sevrin Stevens

*9,5 cm, courbe, pointu*



**A3.3000**

Ciseaux de Westcott

*11,5 cm, courbe, mousse*

## Couteaux

**A1.3405**

Couteau cliveur de Paufique



5mm

**A1.3406**

Couteau cliveur de Paufique



6mm

## Compas

**A2.6000**

Compas de Castroviejo



20mm gradué en 0.5mm

**A2.6020**

Compas de Sourdille



24mm gradué en 0.5mm


## à Implantation



**A2.4400**

Crochet de Sinskey

*Droit*



**A2.4410**

Crochet de Sinskey modifié Cornic

*Courbe*



**A2.4700**

Crochet de Lester


*Droit, extrémité olivaire*



**F903A**

Micro-Manipulateur de Buratto

*Droit, extrémité olivaire*



**A2.4320**

Crochet à iris bouton de col




**A2.4300**

Micro-crochet à iris de Bonn




## à Phaco



**A2.4510**

Manipulateur d'Arneodo

Ø0.4mm



**A2.4511**

Manipulateur d'Arneodo Vachet

Ø0.25mm



**A2.4520**

Manipulateur de Lebuissou

140°, extrémité 9.6mm



**F905B**

Micro-Manipulateur de Pisacano



**F904B**

Micro-Manipulateur de Clayman (Crozafon)



**A2.4500**

Crochet de Jaffe Bechert

141°, extrémité 9.6mm




**A2.4550**

Phaco-Chopper



# CROCHETS

## à Paupière



**A2.4200**

Crochet de Gillis, grand modèle



**A2.4210**

Crochet de Gillis, petit modèle



**A2.4220**

Double crochet à paupière



## à Strabisme

**A2.4010**

Crochet à Strabisme de Graefe

*Extrémité 12 mm***A2.4060**

Crochet de Gass Rouchy

*Extrémité 12 mm perforée***F807B**

Crochet de Green-Malbran

**F808A**

Crochet de Hugonnier

**F810A**

Crochet à strabisme, petit modèle

*Extrémité 8 mm***F811A**

Crochet à strabisme, grand modèle

*Extrémité 12 mm***F807C**

Myomètre de Roth-Rapp

*Instrument associé à la règle/spatule de Pechereau p.40*

# CROCHETS

**A2.4070**

Crochet à DR

*Manche court*



**A2.4110**

Crochet d'Arruga main droite



**A2.4120**

Crochet d'Arruga main gauche



## Curettes

**A2.1101**

Curette à voie lacrymale de J.A. Bernard

Ø 1,0 mm



**A2.1115**

Curette à chalazion de Meyerhoefer

Ø 1,5 mm



**A2.1120**

Curette à chalazion de Meyerhoefer

Ø 2,0 mm



**A2.1125**

Curette à chalazion de Meyerhoefer

Ø 2,5 mm



**A2.1135**

Curette à chalazion de Meyerhoefer

Ø 3,5 mm



**A2.2200**

Curette à éviscération

Ø 8 mm



## Ecarteurs

**A1.2210**

Ecarteur de Bonn



**A1.2300**

Ecarteur de Wolkmann

*Corps plat courbe, 4 griffes mousses*



**A9.2100**

Ecarteur de Knapp

*Corps rond, 4 griffes mousses, 6 mm*



## Marqueurs

**A2.7710**


Marqueur pour le DR




**A4.1400**

Marqueur de Hoffer

$\varnothing$  4 mm



## Capsulaires



**A6.1300**

Pince de Kelman Mc Pherson coudée

*Corps plat, 11 mm, avec plateaux*



**F145C**

Pince de Mc Pherson coudée

*Corps rond, 11 mm, avec plateaux*



## à Capsulorhexis



**A6.1530**

Pince de Corydon courbe

*Bouts pointus, corps plat, titane, incision 2.2 mm*



**A6.1520**

Pince de Corydon courbe

*Bouts pointus, corps rond, titane, incision 2.2 mm*



**F142M**

Pince capsulorhexis de Corydon courbe

*Bouts pointus, corps rond, titane - acier, incision 2.2 mm*



# PINCES



**F142MI**

Pince capsulorhexis du Dr Dimeglio courbe

*Bouts pointus, corps rond, titane-acier, micro-incision 1,8 mm*



**F142MIV**

Pince capsulorhexis micro-incision courbe

*Bouts pointus, corps rond, titane-acier, micro-incision 1,8 mm*



**F142D**

Pince à mouvements croisés du Dr Zaluski


*Bouts pointus, corps rond, titane-acier, micro-incision 1,8 mm*



**A6.1500**

Pince d'Utrata droite


*Bouts mousses, corps plat, incision 2,2 mm*



**A6.1510**

Pince d'Utrata courbe


*Bouts mousses, corps plat, incision 2,2 mm*



**A6.1540**

Pince d'Utrata courbe

*Bouts mousses, corps plat, titane, incision 2,2 mm*



**A6.1550**

Pince d'Utrata courbe

*Bouts mousses, corps rond, titane, incision 2,2 mm*





**F142U**

Pince Ultrata à mouvements croisés du Dr Zaluski

*Bouts mousses, corps rond, titane-acier, incision 1.8 mm*



## Chalazion

**A6.2020**

Pince à chalazion à vis de Desmarres

20 mm



**A6.2026**

Pince à chalazion à vis de Desmarres

26 mm



**F101B**

Pince à chalazion du Dr Sgard autobloquante

26 mm



## à Cils

**A6.3000**

Pince à cils de Barraquer




## Cornée



**A6.7100**

Pince de Bonn

*Micro-plateaux, corps plat, 7 cm  
1 x 2 dents, 0.12 mm*



**A6.7110**

Pince de Bonn

*Micro-plateaux, corps plat, 10 cm  
1 x 2 dents, 0.12 mm*



**A6.7140**

Pince de Bonn


*Micro-plateaux, titane, corps plat, 10 cm  
1 x 2 dents, 0.12 mm*



**A6.7130**

Pince de Bonn

*Micro-plateaux, titane, corps rond, 11 cm  
1 x 2 dents, 0.12 mm*



**F143A**

Pince à cornée de Bonn

*Micro-plateaux, titane-acier, corps rond, 11 cm*





**A6.5150**

Pince Colibri




**A6.7200**

Pince de Barraquer Colibri



*Micro-plateaux  
1x2 dents, 0.12 mm angulées à 90°*



**A6.7210**

Pince de Barraquer Colibri



*Micro-plateaux  
1x2 dents, 0.12 mm angulées à 120°*


## à Disséquer



**A6.3100**

Pince à disséquer droite

*Corps plat, mors striés*



**A6.3120**

Pince à disséquer droite

*Corps plat,  
1x2 dents, 0.7 mm*



**A6.3150**

Pince d'Adson Brown droite

*Corps plat, mors striés*



**A6.3160**

Pince d'Adson droite

*Corps plat  
1x2 dents*



**A6.3170**

Pince d'Adson droite droite

*Corps plat, mors striés*



## Eviscération / Enucléation

**S6.3050**

Pince à « sucre » pour implantation de bille




à Fixer

**A6.6000**

Pince d'Elschnig à droit supérieur droite


Corps plat, 1x2 dents



**A6.6010**

Pince d'Elschnig à droit supérieur courbe

Corps plat, 1x2 dents



**A6.6210**

Pince à fixer de Green


Corps plat, extrémité 10 mm




à Glaucome

**F127B**

Pince de Mermoud



## Hémostatiques

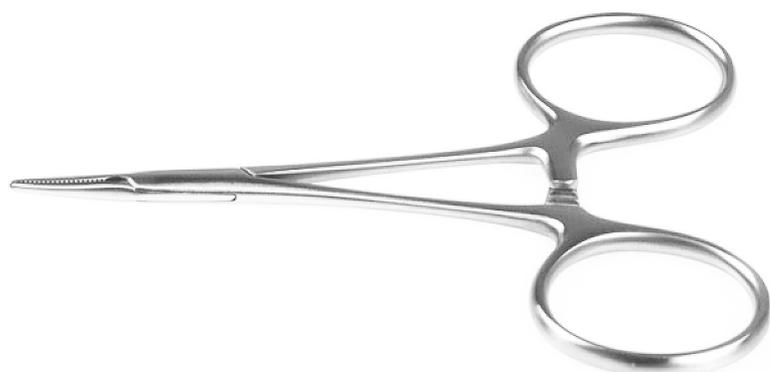

**A6.4000**

Pince de Halsted droite

10 cm, mors striés



**A6.4010**

Pince de Halsted

10 cm, 1x2 dents



**A6.4020**

Pince de Halsted courbe

10 cm, mors striés



**A6.4100**

Pince puce

5 cm, droite

## à Implants


**A6.9160**

Pince à saisir les implants souples



# PINCES


## à Monofilament



**A6.5060**

Pince de Harms Tubingen courbe

*Corps plat, sutures 7.0 à 9.0*



**A6.5100**

Pince de Troutman droite

*Corps plat, sutures 9.0 à 11.0*



**A6.5110**

Pince à monofilament Troutman courbe

*Corps plat, sutures 9.0 à 11.0*



**A6.5120**

Pince de Halsted courbe

*Corps rond, titane*



**A6.5130**

Pince de Halsted courbe

*Corps plat, titane*



**A6.9000**

Pince de Cornic courbe

*Corps plat*



## Rétine




**S5.3100**

Pince de Watzke



## à Strabisme



**F103C**

Pince de Blascovics

Corps plat, à vis, mors striés



## à Suture

**A6.8000**

Pince de Paufique

*Corps plat, dents 0.5 mm*



**A6.8012**

Pince à sutures de Castroviejo

*0.12 mm*

**A6.8030**

Pince à sutures de Castroviejo

*0.3 mm*

**A6.8050**

Pince à sutures de Castroviejo

*0.5 mm*

*Corps plat, droit*



**A6.8060**

Pince de Jayle

*Dents 0.26 mm mors 0.8 mm*



## Divers

**A6.4200**

Pince à champs



# PLAQUE À PAUPIÈRE / PORTE-AIGUILLES

## Plaque à Paupière

**A1.2100**

Plaque à paupières de Jaeger

12 cm



## Porte-Aiguilles

**A7.1000**

Porte-Aiguille de Castroviejo droit

Gros mors, 15 cm



**A7.1010**

Porte-Aiguille de Castroviejo courbe

Gros mors, 15 cm



**A7.1100**

Porte-Aiguille de Castroviejo droit

Mors fins, 15 cm



**A7.1110**

Porte-Aiguille de Castroviejo courbe

Mors fins, 15 cm



# PORTE-AIGUILLES

**A7.1120**

Porte-Aiguille de Castroviejo droit

*Mors fins, 15 cm  
A arrêt*



**A7.1130**

Porte-Aiguille de Castroviejo courbe

*Mors fins, 15 cm  
A arrêt*



**A7.1200**

Porte-Aiguille gros manche



**A7.1400**

Porte-Aiguille de Halsey

**A7.1410**

Porte-Aiguille de Halsey mors tungstène



**A7.2010**

Micro Porte-Aiguille de Castroviejo courbe

*Mors fins, 12 cm*



# PORTE-AIGUILLES

**A7.3010**

Micro Porte-Aiguille Barraquer Troutman courbe

*Mors très fins, 10 cm*



**A7.3100**

Porte-Aiguille de Barraquer droit

*Mors très fins, 13 cm*



**A7.3110**

Porte-Aiguille de Barraquer courbe

*Mors très fins, 13 cm*



**A7.3130**

Porte-Aiguille de Barraquer courbe

*Mors très fins, 13 cm  
A arrêt*



**A7.3200**

Micro Porte-Aiguille de Cornic

*Micro-mors, becs dégagés, 13 cm*



**A7.3210**

Micro Porte-Aiguille de Cornic

*Micro-mors, becs dégagés, titane, 13 cm*



## Porte-Lames

**A1.5000**

Porte-lame de Troutman

*Droit, 9 cm*



**A1.5040**

Lames de rasoir

*Paquet de 10*



**A1.6000**

Manche bistouri n°3




## Réglettes

**F182A**


Réglette/Spatule de Pechereau

*Instrument associé au Myomètre de Roth-Rapp p.21*

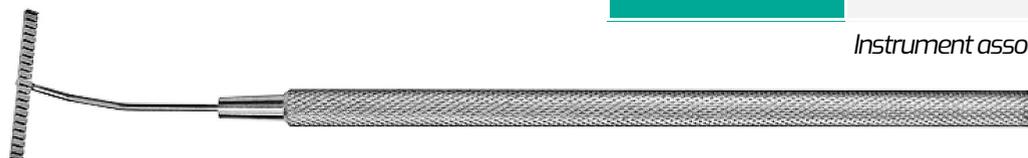

**A1.2350**

Réglette de 10 cm, graduée en demi mm



## Releveurs

**A1.2010**

Releveur à paupières de Desmarres

10 mm



**A1.2012**

Releveur à paupières de Desmarres

12 mm



**A1.2014**

Releveur à paupières de Desmarres

14 mm



## Rongeur

**A9.1000**

Rongeur à DCR de Kerrison

3 mm



Echelle 1/2

## Spatules

**A2.3401**

Spatule à Iris de Culler



Largeur de 1mm

**A2.3500**

Spatule de Barraquer



Très fine, longueur de 12 mm

**A2.3600**

Spatule de Cornic



**A2.3720**

Bissecteur de Teyssier



**F182A**

Réglette / Spatule de Pechereau



Instrument associé au Myomètre de Roth-Rapp p.21

## Trépan





**A1.8165**

Trépan

16.5 mm

## Voies Lacrymales

	<b>A8.4000</b>	Stylet dilatateur de Sichel Wilder — fin
	<b>A8.4010</b>	Stylet dilatateur de Sichel Wilder — moyen
	<b>A8.4020</b>	Stylet dilatateur de Sichel Wilder — fort
	<b>A8.4050</b>	Stylet dilatateur Double
	<b>A8.4060</b>	Sonde à voie lacrymale
	<b>A8.4110</b>	Sonde de Galezowski 000 <i>∅ 0.6 mm</i>
	<b>A8.4120</b>	Sonde de Galezowski 00 <i>∅ 0.7 mm</i>
	<b>A8.4130</b>	Sonde de Galezowski 0 <i>∅ 0.8 mm</i>
	<b>A8.4140</b>	Sonde de Galezowski 1 <i>∅ 0.9 mm</i>
	<b>A8.4150</b>	Sonde de Galezowski 2 <i>∅ 1.0 mm</i>
	<b>A8.4160</b>	Sonde de Galezowski 3 <i>∅ 1.1 mm</i>
	<b>A8.4170</b>	Sonde de Galezowski 4 <i>∅ 1.2 mm</i>
	<b>A8.4180</b>	Sonde de Galezowski 5 <i>∅ 1.4 mm</i>

## Boite de Chirurgie Paupière



①	<b>A3.1400</b>	<b>Ciseaux de Joseph droits</b> , pointu 14.5 cm
②	<b>A3.1210</b>	<b>Ciseaux de Sevrin Stevens</b> , courbe, bout mousse
③	<b>A2.4210 x 2</b>	<b>Crochets de Gillis</b> , petits
④	<b>A1.6000</b>	<b>Manche bistouri n°3</b>
⑤	<b>A6.3170</b>	<b>Pince d'Adson droite</b> , mors striés, sans griffe
⑥	<b>A6.4020 x 2</b>	<b>Pinces de Halstead courbes</b> , sans griffes, 11 cm
⑦	<b>A6.8060</b>	<b>Pince de Jayle</b> , 1x2 dents de 0.25mm
⑧	<b>A7.1010</b>	<b>Porte-aiguille de Castroviejo</b> , sans arrêt, courbe
⑨	<b>A7.1410</b>	<b>Porte-aiguille de Halsey</b> , mors en tungstène, 13cm
⑩	<b>A1.2014</b>	<b>Releveur de paupière de Desmarres</b> , 14mm
⑪	<b>A8.3005</b>	<b>Boite de stérilisation</b> , grande

## Complément de gamme

A3.3100 Ciseaux de Castroviejo courbes, bouts mousses, 12 cm



A3.1410 Ciseaux de Ragnell courbes, bouts mousses



A3.4010 Ciseaux de Vannas courbes, bouts mousses



A3.3000 Ciseaux de Wescott courbes, bouts mousses



A2.6020 Compas de Sourdille 24 mm, gradué en 0,5 mm



A2.4200 Crochet de Gillies, grand



A1.2210 Ecarteur de Bonn



A1.2300 Ecarteur de Wolkmann, 4 griffes



A6.4200 Pince à champs



A6.7110 Pince de Bonn



A6.8000 Pince de Paufigue



A1.2100 Plaque à paupière



A7.1200 Porte-aiguille gros manche



A1.2350 Réglette graduée, 10 cm



A8.4050 Stylet dilatateur double



## Boite de Chirurgie Rétine



①	<b>A1.1400</b>	Blépharostat de Castroviejo
②	<b>A3.3100</b>	Ciseaux de Castroviejo, mousse
③	<b>A2.6000</b>	Compas de Castroviejo
④	<b>A3.1210</b>	Ciseaux de Sevrins Stevens, courbes bout mousse
⑤	<b>A2.4060</b>	Crochet de Gass Rouchy
⑥	<b>A1.2210</b>	Ecarteur de Bonn, 10 cm
⑦	<b>A2.7710</b>	Marqueur scléral
⑧	<b>A6.7110</b>	Pince de Bonn
⑨	<b>A6.4000</b>	Pince de Halstead
⑩	<b>A6.8000</b>	Pince de Paufigue
⑪	<b>A6.4100 x 4</b>	Pinces puces
⑫	<b>A7.1110</b>	Porte-aiguille de Castroviejo
⑬	<b>A8.3005</b>	Boîte de stérilisation, grande

## Complément de gamme

A3.1130 Ciseaux d'ophtalmologie



A2.4070 Crochet à décollement de rétine



A3.4030 Micro-ciseaux Vannas courbes, bouts mousses



A6.8012 Pince à suture de Castroviejo, 1 x 2 dents 0,12 mm



A6.8030 Pince à suture de Castroviejo, 1 x 2 dents 0,30 mm



A6.8050 Pince à suture de Castroviejo, 1 x 2 dents 0,50 mm



A7.3130 Porte-aiguille de Barraquer, courbe, 13 cm



A9.61.43.23 Pic à membrane, 23 Ga

A9.61.43.25 Pic à membrane, 25 Ga



PINCES ET CISEAUX DISPONIBLES EN 20, 23 ET 25 Ga,  
NOUS CONSULTER.



## Boite Enucléation / Eviscération

A10.1100

<b>A2.2200</b>	Curette à éviscération
<b>A2.4010</b>	Crochet à strabisme de Graefe
<b>A2.4060</b>	Crochet de Gass Rouchy
<b>A3.1010</b>	Ciseaux de Bonn, 9 cm, lames 15 mm, courbe, bouts mousses
<b>A3.1020</b>	Ciseaux de Bonn, 9 cm, lames 15 mm, droit, bouts pointus
<b>A3.1300</b>	Ciseaux à énucléation
<b>A6.4100 x4</b>	Pince puce
<b>A6.5060</b>	Pince de Harms Tubingen
<b>A6.8000</b>	Pince de Paufique
<b>A7.1110</b>	Porte-aiguille de Castroviejo, 15 cm, courbe, mors fins,
<b>A8.3010</b>	Boite de stérilisation, grande—2 étages
<b>F307E</b>	Blépharostat de Corcelle à vis

## Boite Chalazion

A10.1500

<b>A1.2100</b>	Plaque à paupière de Jaeger
<b>A1.6000</b>	Manche bistouri n°5
<b>A2.1125</b>	Curette à chalazion de Meyerhoefer
<b>A3.1030</b>	Ciseaux de Bonn, 9 cm, lames 15 mm, courbe, bouts pointus
<b>A6.2026</b>	Pince à chalazion de Desmarres
<b>A6.8050</b>	Pince à sutures de Castroviejo, 0.5 mm
<b>A7.1110</b>	Porte-aiguille de Castroviejo
<b>A8.3005</b>	Boite de stérilisation, grande

## Boite à Ptérygion

A10.1600

<b>A1.3405</b>	Couteau cliveur de Paufique, 5 mm
<b>A1.3406</b>	Couteau de Paufique, 6 mm
<b>A1.6000</b>	Manche bistouri n°3
<b>A3.1030</b>	Ciseaux de Bonn, 9 cm, lames 15 mm, courbe, bouts pointus
<b>A3.3000</b>	Ciseaux de Westcott, 11.5 cm, courbe, bouts mousses
<b>A6.6210</b>	Pince d'Alschmig à droit supérieur
<b>A6.8000</b>	Pince de Paufique
<b>A6.8030</b>	Pince à sutures de Castroviejo, 0.3 mm
<b>A7.1110</b>	Porte-aiguille de Castroviejo, 15 cm, courbe, mors fins
<b>A8.3005</b>	Boite de stérilisation, grande

## Boite Voies Lacrymales

A10.1700

<b>A5.5000</b>	Canule de Galezowki, droite 14 mm
<b>A5.5200</b>	Canule de Galezowki, droite 18 mm
<b>A8.4000</b>	Stylet dilataleur de Sichel Wilder
<b>A8.4010</b>	Stylet dilataleur de Sichel Wilder
<b>A8.4050</b>	Stylet dilataleur de Sichel Wilder
<b>A8.4120</b>	Sonde de Galezowski 00
<b>A8.4130</b>	Sonde de Galezowski 0
<b>A8.4140</b>	Sonde de Galezowski 1
<b>A8.4150</b>	Sonde de Galezowski 2
<b>A8.3003</b>	Boite de stérilisation, moyenne

## Boite à Enlever les fils

A10.2000

<b>A1.1020</b>	<b>Blépharostat de Barraquer Colibri, 15 mm</b>
<b>A5.2113</b>	<b>Canule de Rycroft, 0.3 mm</b>
<b>A6.4100</b>	<b>Pince puce</b>
<b>A6.7210</b>	<b>Pince de Barraquer Colibri</b>
<b>A8.3003</b>	<b>Boite de stérilisation, moyenne</b>
<b>F1521MP</b>	<b>Micro-ciseaux de Vannas</b>

## Boite à Extraction des corps étrangers

A10.2500

<b>A1.1020</b>	<b>Blépharostat de Barraquer Colibri, 15 mm</b>
<b>A2.1115</b>	<b>Curette à chalazion de Meyerhoefer, 15 mm</b>
<b>A8.3003</b>	<b>Boite de stérilisation, moyenne</b>

## Boite Cataracte Phaco/Micro-incisions

A10.3000

<b>A1.1030</b>	<b>Blépharostat pour phaco</b>
<b>A2.4510</b>	<b>Manipulateur d'Arneodo</b>
<b>A3.1010</b>	<b>Ciseaux de Bonn, 9 cm, lames 15 mm, courbe, bouts mousses</b>
<b>A5.1341</b>	<b>Canule d'irrigation, 1.0 mm</b>
<b>A5.1460</b>	<b>Canule de Chazalon</b>
<b>A6.5110</b>	<b>Pince à monofilament de Troutman</b>
<b>A6.7110</b>	<b>Pince de Bonn</b>
<b>A7.3010</b>	<b>Micro porte-aiguille de Barraquer Troutman</b>
<b>A8.3005</b>	<b>Boite de stérilisation, grande</b>
<b>F142MI</b>	<b>Pince capsulorhexis micro-incision</b>

## Boite à Glaucome

A10.4000

<b>A1.1100</b>	Blépharostat de Corcelle	<b>A5.2200</b>	Canule de Barraquer, bout olivaire
<b>A1.3406</b>	Couteau cliveur de Paufique, 6 mm	<b>A6.5110</b>	Pince à monofilament de Troutman
<b>A1.5000</b>	Porte-lame de Troutman	<b>A6.6000</b>	Pince d'Alschmig à droit supérieur, droite
<b>A1.5040</b>	Lames de rasoir	<b>A6.7210</b>	Pince de Barraquer Colibri
<b>A2.3401</b>	Spatule à iris de Culler	<b>A6.8000</b>	Pince de Paufique
<b>A2.3500</b>	Spatule de Barraquer	<b>A7.1100</b>	Porte-aiguille de Castroviejo
<b>A3.4010</b>	Ciseaux de Vannas, courbe	<b>A7.3110</b>	Porte-aiguille de Barraquer
<b>A3.4020</b>	Ciseaux de Vannas, droit	<b>A8.3010</b>	Boite de stérilisation, grande—2 étages

## Boite à Strabisme

A10.6000

<b>A1.1400</b>	Blépharostat de Castroviejo	<b>A6.8000</b>	Pince de Paufique
<b>A1.2012</b>	Releveur à paupière de Desmarres, 12 mm	<b>A6.8030</b>	Pince à sutures de Castroviejo, 0,3 mm
<b>A2.4010</b>	Crochet à strabisme de Graefe	<b>A7.1110</b>	Porte-aiguille de Castroviejo
<b>A2.6000</b>	Compas de Castroviejo	<b>A7.3110</b>	Porte-aiguille de Barraquer
<b>A3.1210</b>	Ciseaux de Sevrin Stevens, courbe, mousse	<b>A8.3010</b>	Boite de stérilisation, grande—2 étages
<b>A3.3000</b>	Ciseaux de Westcott, courbe, mousse	<b>F103C</b>	Pince de Blascovics
<b>A5.5000</b>	Canule de Galezowski, 14 mm, droite	<b>F182A</b>	Réglette de Pechereau
<b>A6.4010</b>	Pince de Halsted, 10 cm, 1 x 2 dents	<b>F807C</b>	Myomètre de Roth-Rapp
<b>A6.4100 x2</b>	Pince puce	<b>F808A</b>	Crochet de Hugonnier

# INDEX ALPHANUMERIQUE

<b>A1.1000</b>	Blépharostat de Barraquer Colibri	p.2	<b>A2.4200</b>	Crochet de Gillis	p.20
<b>A1.1010</b>	Blépharostat de Barraquer Colibri	p.2	<b>A2.4210</b>	Crochet de Gillis	p.20
<b>A1.1020</b>	Blépharostat de Barraquer Colibri	p.2	<b>A2.4220</b>	Double crochet à paupière	p.20
<b>A1.1030</b>	Blépharostat de Kratz	p.2	<b>A2.4300</b>	Micro-crochet à iris de Bonn	p.18
<b>A1.1100</b>	Blépharostat de Corcelle	p.3	<b>A2.4320</b>	Crochet bouton de col	p.18
<b>A1.1400</b>	Blépharostat de Castroviejo	p.3	<b>A2.4400</b>	Crochet de Sinskey	p.18
<b>A1.2010</b>	Releveur à paupière de Desmarres	p.41	<b>A2.4410</b>	Crochet de Sinskey - Cornic	p.18
<b>A1.2012</b>	Releveur à paupière de Desmarres	p.41	<b>A2.4500</b>	Crochet de Jaefe Bechert	p.19
<b>A1.2014</b>	Releveur à paupière de Desmarres	p.41	<b>A2.4510</b>	Manipulateur d'Arneodo	p.19
<b>A1.2100</b>	Plaque à paupière de Jaeger	p.37	<b>A2.4511</b>	Manipulateur d'Arneodo Vachet	p.19
<b>A1.2210</b>	Ecarteur de Bonn	p.24	<b>A2.4520</b>	Manipulateur de Lebuissou	p.19
<b>A1.2300</b>	Ecarteur de Wolkman	p.24	<b>A2.4550</b>	Phaco-Chopper	p.19
<b>A1.2350</b>	Réglette en demi mm	p.40	<b>A2.4700</b>	Anse de Lester	p.18
<b>A1.3405</b>	Couteau cliveur de Paufigue	p.17	<b>A2.5000</b>	Anse de Snellen	p.1
<b>A1.3406</b>	Couteau cliveur de Paufigue	p.17	<b>A2.5100</b>	Anse irrigatrice de Pearce	p.1
<b>A1.4000</b>	Aiguille à corps étrangers	p.1	<b>A2.6000</b>	Compas de Castroviejo	p.17
<b>A1.5000</b>	Porte-lame de Troutman	p.40	<b>A2.6020</b>	Compas de Sourdille	p.17
<b>A1.5040</b>	Lames de rasoir	p.40	<b>A2.7710</b>	Marqueur pour le DR	p.24
<b>A1.6000</b>	Manche bistouri n°3	p.40	<b>A3.1000</b>	Ciseaux de Bonn	p.14
<b>A1.8165</b>	Trépan 16,5 mm	p.42	<b>A3.1010</b>	Ciseaux de Bonn	p.14
<b>A2.1101</b>	Curette à VL de J.A. Bernard	p.23	<b>A3.1020</b>	Ciseaux de Bonn	p.14
<b>A2.1115</b>	Curette à chalazion de Meyerhoefer	p.23	<b>A3.1030</b>	Ciseaux de Bonn	p.14
<b>A2.1120</b>	Curette à chalazion de Meyerhoefer	p.23	<b>A3.1100</b>	Ciseaux d'Ophtalmologie	p.15
<b>A2.1125</b>	Curette à chalazion de Meyerhoefer	p.23	<b>A3.1110</b>	Ciseaux d'Ophtalmologie	p.15
<b>A2.1135</b>	Curette à chalazion de Meyerhoefer	p.23	<b>A3.1120</b>	Ciseaux d'Ophtalmologie	p.15
<b>A2.2200</b>	Curette à éviscération	p.23	<b>A3.1130</b>	Ciseaux d'Ophtalmologie	p.15
<b>A2.3401</b>	Spatule à iris de Culler	p.42	<b>A3.1200</b>	Ciseaux de Sevrin Stevens	p.16
<b>A2.3500</b>	Spatule de Barraquer	p.42	<b>A3.1210</b>	Ciseaux de Sevrin Stevens	p.16
<b>A2.3600</b>	Spatule de Cornic	p.42	<b>A3.1220</b>	Ciseaux de Sevrin Stevens	p.16
<b>A2.3720</b>	Bissecteur de Teyssier	p.42	<b>A3.1230</b>	Ciseaux de Sevrin Stevens	p.16
<b>A2.4010</b>	Crochet à strabisme de Graefe	p.21	<b>A3.1300</b>	Ciseaux à énucléation	p.13
<b>A2.4060</b>	Crochet de Gass Rouchy	p.21	<b>A3.2000</b>	Ciseaux à iridectomie de Wecker	p.13
<b>A2.4070</b>	Crochet à DR	p.22	<b>A3.2010</b>	Ciseaux à iridectomie Barraquer	p.13
<b>A2.4110</b>	Crochet d'Arruga	p.22	<b>A3.3000</b>	Ciseaux de Westcott	p.16
<b>A2.4120</b>	Crochet d'Arruga	p.22	<b>A3.3100</b>	Ciseaux de Castroviejo	p.12
			<b>A3.3110</b>	Ciseaux de Castroviejo	p.12

# INDEX ALPHANUMERIQUE

REFERENCE / DENOMINATION / PAGE

<b>A3.3250</b>	Ciseaux de Katzin à lames inversées	p.12	<b>A5.2000</b>	Canule pour le healon	p.7
<b>A3.3260</b>	Ciseaux de Katzin à lames inversées	p.12	<b>A5.2113</b>	Canule de Rycroft	p.7
<b>A3.3270</b>	Micro-ciseaux de Katzin à lames inversées	p.12	<b>A5.2114</b>	Canule de Rycroft	p.7
<b>A3.3280</b>	Micro-ciseaux de Katzin à lames inversées	p.12	<b>A5.2200</b>	Canule de Barraquer	p.7
<b>A3.4000</b>	Ciseaux de Vannas	p.11	<b>A5.4100</b>	Canule gratteuse	p.7
<b>A3.4010</b>	Ciseaux de Vannas	p.11	<b>A5.4200</b>	Canule de Charleux gratteuse	p.7
<b>A3.4020</b>	Ciseaux de Vannas	p.11	<b>A5.4300</b>	Canule de Kratz gratteuse	p.7
<b>A3.4030</b>	Ciseaux de Vannas	p.11	<b>A5.5000</b>	Canule de Galezowki	p.10
<b>A3.5000</b>	Ciseaux à capsule de Cornic	p.13	<b>A5.5200</b>	Canule de Galezowki	p.10
<b>A4.1400</b>	Marqueur optique de Hoffer	p.24	<b>A6.1300</b>	Pince de Kelman Mac Pherson	p.25
<b>A5.1000</b>	Canule de Charleux	p.6	<b>A6.1500</b>	Pince d'Utrata	p.26
<b>A5.1010</b>	Canule de Charleux	p.6	<b>A6.1510</b>	Pince d'Utrata courbe	p.26
<b>A5.1015</b>	Canule de Charleux	p.6	<b>A6.1520</b>	Pince de Corydon	p.25
<b>A5.1020</b>	Canule de Charleux	p.6	<b>A6.1530</b>	Pince de Corydon	p.25
<b>A5.1050</b>	Canule de Simcoe	p.6	<b>A6.1540</b>	Pince d'Utrata	p.26
<b>A5.1100</b>	Canule de Binkhorst	p.6	<b>A6.1550</b>	Pince d'Utrata	p.26
<b>A5.1110</b>	Canule de Binkhorst à gauche	p.6	<b>A6.2020</b>	Pince à chalazion de Desmarres	p.27
<b>A5.1120</b>	Canule de Binkhorst à droite	p.6	<b>A6.2026</b>	Pince à chalazion de Desmarres	p.27
<b>A5.1213</b>	Canule THX double courant	p.8	<b>A6.3000</b>	Pince à cils de Barraquer	p.27
<b>A5.1222</b>	Canule THX double courant	p.8	<b>A6.3100</b>	Pince à disséquer	p.30
<b>A5.1234</b>	Canule THX double courant	p.8	<b>A6.3120</b>	Pince à disséquer	p.30
<b>A5.1235</b>	Canule THX Teyssier	p.8	<b>A6.3150</b>	Pince d'Adson Brown	p.30
<b>A5.1240</b>	Canule THX Teyssier	p.8	<b>A6.3160</b>	Pince d'Adson	p.30
<b>A5.1300</b>	Canule double courant de Simcoe inversée	p.8	<b>A6.3170</b>	Pince d'Adson droite	p.30
<b>A5.1341</b>	Canule d'irrigation	p.6	<b>A6.4000</b>	Pince de Halsted	p.32
<b>A5.1342</b>	Canule d'irrigation	p.6	<b>A6.4010</b>	Pince de Halsted	p.32
<b>A5.1343</b>	Canule de Guerin	p.6	<b>A6.4020</b>	Pince de Halsted	p.32
<b>A5.1344</b>	Canule de Guerin	p.7	<b>A6.4100</b>	Pince puce	p.32
<b>A5.1350</b>	Canule double courant de Simcoe originale	p.9	<b>A6.4200</b>	Pince à champs	p.36
<b>A5.1400</b>	Canule THX double courant "club de golf"	p.9	<b>A6.5060</b>	Pince de Harms Tubingen	p.34
<b>A5.1410</b>	Canule THX double courant "club de golf"	p.9	<b>A6.5100</b>	Pince à monofilament de Troutman	p.34
<b>A5.1450</b>	Tube silicone	p.9	<b>A6.5110</b>	Pince à monofilament de Troutman	p.34
<b>A5.1460</b>	Canule de Chazalon	p.7	<b>A6.5120</b>	Pince à monofilament	p.34
<b>A5.1465</b>	Canule de Chazalon	p.7	<b>A6.5130</b>	Pince à monofilament	p.34
<b>A5.1470</b>	Canule pour Lasik	p.10	<b>A6.5150</b>	Pince Colibri	p.28
<b>A5.1500</b>	Canule THX modifiée Laforge	p.9	<b>A6.6000</b>	Pince d'Elschnig à droit supérieur	p.31
<b>A5.1600</b>	Canule pour hydrodissection	p.7			

# INDEX ALPHANUMERIQUE

<b>A6.6010</b>	Pince d'Elschnig à droit supérieur	p.31	<b>A8.4050</b>	Stylet dilatateur double	p.43
<b>A6.6210</b>	Pince d'Elschnig à droit supérieur	p.31	<b>A8.4060</b>	Sonde de Galezowski	p.43
<b>A6.7100</b>	Pince de Bonn	p.28	<b>A8.4110</b>	Sonde de Galezowski	p.43
<b>A6.7110</b>	Pince de Bonn	p.28	<b>A8.4120</b>	Sonde de Galezowski	p.43
<b>A6.7130</b>	Pince de Bonn	p.28	<b>A8.4130</b>	Sonde de Galezowski	p.43
<b>A6.7140</b>	Pince de Bonn	p.28	<b>A8.4140</b>	Sonde de Galezowski	p.43
<b>A6.7200</b>	Pince de Barraquer Colibri	p.29	<b>A8.4150</b>	Sonde de Galezowski	p.43
<b>A6.7210</b>	Pince de Barraquer Colibri	p.29	<b>A8.4160</b>	Sonde de Galezowski	p.43
<b>A6.8000</b>	Pince de Paufique	p.36	<b>A8.4170</b>	Sonde de Galezowski	p.43
<b>A6.8012</b>	Pince à sutures de Castroviejo	p.36	<b>A8.4180</b>	Sonde de Galezowski	p.43
<b>A6.8030</b>	Pince à sutures de Castroviejo	p.36	<b>A9.1000</b>	Rongeur de Kerrison	p.41
<b>A6.8050</b>	Pince à sutures de Castroviejo	p.36	<b>A9.2100</b>	Ecarteur de Knapp	p.24
<b>A6.8060</b>	Pince de Jayle	p.36	<b>F101B</b>	Pince à chalazion du Dr Sgard	p.27
<b>A6.9000</b>	Pince de Cornic	p.34	<b>F103C</b>	Pince de Blascovics	p.35
<b>A6.9160</b>	Pince à saisir les implants souples	p.33	<b>F127B</b>	Pince de Mermoud	p.31
<b>A7.1000</b>	Porte-aiguille de Castroviejo	p.37	<b>F142D</b>	Pince à mouvements croisés du Dr Zaluski	p.26
<b>A7.1010</b>	Porte-aiguille de Castroviejo	p.37	<b>F142M</b>	Pince capsulorhexis de Corydon	p.25
<b>A7.1100</b>	Porte-aiguille de Castroviejo	p.37	<b>F142MI</b>	Pince capsulorhexis Dr Dimeglio	p.26
<b>A7.1110</b>	Porte-aiguille de Castroviejo	p.37	<b>F142MIV</b>	Pince capsulorhexis micro-incision	p.26
<b>A7.1120</b>	Porte-aiguille de Castroviejo à arrêt	p.38	<b>F142U</b>	Pince Utrata, mouvements croisés, Dr Zaluski	p.27
<b>A7.1130</b>	Porte-aiguille de Castroviejo à arrêt	p.38	<b>F143A</b>	Pince à cornée de Bonn	p.28
<b>A7.1200</b>	Porte-aiguille gros manche	p.38	<b>F145C</b>	Pince de Mac Pherson	p.25
<b>A7.1400</b>	Porte-aiguille de Halsey	p.38	<b>F1520I</b>	Micro-ciseaux coupe implants Dr Jadé	p.13
<b>A7.1410</b>	Porte-aiguille de Halsey	p.38	<b>F1520P</b>	Micro-ciseaux de Vannas droit	p.11
<b>A7.2010</b>	Micro porte-aiguille de Castroviejo	p.38	<b>F1521MP</b>	Micro-ciseaux de Vannas	p.11
<b>A7.3010</b>	Micro porte-aiguille Barraquer Troutman	p.39	<b>F182A</b>	Réglette/Spatule de Pechereau	p.40 / p.42
<b>A7.3100</b>	Porte-aiguille de Barraquer	p.39	<b>F304B</b>	Blépharostat de Kratz (temporale)	p.2
<b>A7.3110</b>	Porte-aiguille de Barraquer	p.39	<b>F307B</b>	Blépharostat de Corcelle à vis	p.3
<b>A7.3130</b>	Porte-aiguille de Barraquer à arrêt	p.39	<b>F307E</b>	Blépharostat Colibri réglable	p.3
<b>A7.3200</b>	Micro porte-aiguille de Cornic	p.39	<b>F804B</b>	Micro-manipulateur de Clayman	p.19
<b>A7.3210</b>	Micro porte-aiguille de Cornic	p.39	<b>F805B</b>	Micro-manipulateur de Buratto	p.19
<b>A8.3000</b>	Boite de stérilisation, petite	p.4	<b>F807B</b>	Crochet de Green-Malbran	p.21
<b>A8.3003</b>	Boite de stérilisation, moyenne	p.4	<b>F807C</b>	Myomètre de Roth-Rapp	p.21
<b>A8.3005</b>	Boite de stérilisation, grande	p.5	<b>F808A</b>	Crochet de Hugonnier	p.21
<b>A8.3010</b>	Boite de stérilisation, grande— 2 étages	p.5	<b>F810A</b>	Crochet à strabisme petit modèle	p.21
<b>A8.4000</b>	Stylet dilatateur de Sichel Wilder	p.43	<b>F811A</b>	Crochet à strabisme grand modèle	p.21
<b>A8.4010</b>	Stylet dilatateur de Sichel Wilder	p.43	<b>F903A</b>	Micro-manipulateur de Buratto	p.18
<b>A8.4020</b>	Stylet dilatateur de Sichel Wilder	p.43	<b>S5.3100</b>	Pince de Watzke	p.30
			<b>S6.3050</b>	Pince à sucre pour bille	p.31



# CONDITIONS GENERALES DE VENTE

## GÉNÉRALITÉS

Les prix et renseignements portés sur les catalogues, prospectus et tarifs sont donnés à titre indicatif.

La Société se réserve le droit d'apporter toutes modifications de présentation de forme, de dimension, de conception ou matières à ses produits dont les gravures et les descriptions figurent sur les imprimés de publicité. La Société n'est liée par les engagements qui pourraient être pris par ses représentants ou employés que sous réserve de confirmation écrite par elle-même des dits engagements.

Les propositions faites par la Société sont remises à titre indicatif, aucune réception de fonds préalable à la vente ne peut constituer engagement. L'acceptation des offres implique l'adhésion aux présentes conditions, sauf cas de stipulations contraires précises incluses dans les textes des acceptations de commande.

Pour être admises, les réclamations sur la composition, la quantité et les poids des produits livrés ou leur non-conformité avec le bordereau d'expédition doivent être formulées par lettre recommandée avec avis de réception dans les huit jours de l'arrivée de la marchandise sans préjudice des dispositions à prendre à l'égard du transporteur.

Les fournitures additionnelles à la commande feront l'objet d'un nouveau contrat de vente mentionnant les prix, conditions, délais, etc. qui les concernent.

## LIVRAISON—TRANSPORT—PRIX

La livraison est effectuée soit par la remise directe des marchandises au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par la délivrance dans les usines ou magasin de la Société à un expéditeur ou un transporteur.

Les marchandises de la Société voyagent aux risques et périls du client, même en cas de retour ou d'un envoi franco de port ou contre remboursement.

La Société ne peut être tenue responsable des dommages survenus au cours du transport.

En conséquence, il appartient au client de procéder à la vérification quantitative et qualitative des produits à leur réception. Les réserves précisant le type de dommage et son importance doivent être faites sur le récépissé du transporteur et confirmées à celui-ci (par lettre recommandée avec avis de réception) dans les trois jours francs suivant la réception (article 105 du Code de Commerce). Ces précautions permettent au transporteur seul responsable d'entreprendre une action auprès de son assurance.

Les conditionnements ne sont jamais fractionnés et sont facturés en boîtage standard.

**Pour toute commande inférieure à 220 Euros hors taxes (deux cent vingt euros), une participation forfaitaire aux frais de port, d'un montant de 6€, sera à la charge de l'acheteur.**

**Les commandes égales ou supérieures à 220 Euros hors taxes (deux cent vingt euros) sont expédiées franco de port.**

**Les commandes sont facturées selon le tarif en vigueur à la date de commande.**

## DELAI DE LIVRAISON

Si la livraison est retardée sur la demande de l'acheteur ou pour une cause quelconque indépendante de la volonté de la Société, et si la Société y consent, les produits sont emmagasinés, s'il y a lieu, aux frais et risques de l'acheteur, la Société déclinant toute responsabilité consécutive à ce retard.

Ces dispositions ne modifient en rien les obligations de paiement de la fourniture et ne constituent pas novation.

Les délais de livraison sont maintenus dans la limite du possible, mais ces délais étant donnés à titre indicatif, les retards ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation de la commande ni l'octroi d'une indemnité.

La Société est dégagée, de plein droit, de tout engagement relatif aux délais de livraison :

- Dans le cas où les conditions de paiement n'auraient pas été observées par l'acheteur,
- Dans le cas où les renseignements à fournir, par l'acheteur, ne seraient pas parvenus en temps voulu,
- En cas de force majeure ou d'événements tels que black out, grève, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accident d'outillages, rebuts de pièces importantes en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause amenant un chômage total ou partiel pour le fabricant ou ses fournisseurs.

La Société, dans toute la mesure de ses moyens, tiendra l'acheteur au courant, en temps opportun, des cas ou événements ci-dessus énumérés.

## RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

La marchandise reste la propriété de la Société jusqu'au paiement complet, lors de la remise des traites ou des chèques jusqu'à leur encaissement. Des dispositions spéciales comme par exemple la mise en gage, transmission d'assurance ou autres ne sont uniquement autorisées qu'après l'accord écrit de la Société.

En cas de vente de la marchandise, le nouvel acquéreur est redevable à la Société jusqu'à l'exécution du paiement et jusqu'à concurrence du montant dû.

## PAIEMENT

**Les factures sont payables à la date d'échéance prévue sur chacune d'elles en conformité avec le délai règlement accordé par FCI SAS. Conformément à l'article L 441-6 du code de commerce en cas de retard de règlement des pénalités seront appliquées. Le taux des pénalités est égal à trois fois le taux d'intérêt légal soit au 01 janvier 2013 un taux de 2.13 %. Il sera également appliqué une indemnité forfaitaire pour frais recouvrement d'un montant de 40 € par facture.**

## CLAUSE RÉSOLUTOIRE

La vente sera résiliée de plein droit si bon semble à la Société, en cas de non-paiement dans le délai fixé soit de la totalité, soit d'une partie ou du solde du prix à l'une des échéances convenues.

Dès réception d'une lettre recommandée de la Société se prévalant de ladite clause, l'acheteur devra immédiatement leur remettre les marchandises se trouvant encore en sa possession.

Si la Société est amenée à faire jouer cette clause résolutoire et donc à reprendre les marchandises vendues, les acomptes perçus lui resteront définitivement acquis comme indemnité forfaitaire à titre de clause pénale sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

## CONTESTATIONS

En cas de contestation à quelque titre que ce soit, le client accepte d'avance la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de PARIS. L'acceptation de traite ou de tout autre document n'apporte ni novation, ni dérogation à cette attribution de juridiction.

## CONDITIONS PARTICULIÈRES

S'il n'y a pas identité absolue entre les conditions générales exposées ci-dessus et les conditions particulières de la Société, il est expressément stipulé que les clauses particulières de la Société ont primauté sur celles des conditions générales qui ne sont pas conformes.



Avant toute utilisation d'un dispositif médical,  
FCI vous invite à lire attentivement les instructions  
figurant dans la notice qui l'accompagne

FCI018/016 Ind B - Septembre 2018 - Société par actions simplifiées au capital de 46 909€ - SIREN 351 670 385 - RCS PARIS



**FCI S.A.S.**

20 / 22 Rue Louis Armand - 75015 Paris - France

Tél : 01 53 98 98 98

Fax : 01 53 98 98 99

fci@fci.fr / www.fci.fr